



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej**



Wrocław, dn. 12.08.2015r.

EZ/ *M502* /15

Dotyczy: pytań i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawy narzędzi i aparatury medycznej (sygnatura sprawy EZ/345/109/15).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

**Zadanie 1 – Karta parametrów**

**1. Pytanie**

„Czy dopuścicie Państwo napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich o frezarskich oraz piłę oscylacyjną o następujących parametrach (parametry niewymienione bez zmian):

|   |
|---|
| Pistoletowa rękojeść wiertarska nie wymagająca smarowania w pełni autoklawowalna  |
| Silnik o mocy $\geq 240W$ sterowany elektronicznie  |
| Regulacja obrotów w zakresie minimum:   |
| • 75-1300 obr/min dla nasadek wiertarskich  |
| • 20-300 obr/min dla nasadek frezerskich  |
| Piła oscylacyjna o obrotowej głowicy i oscylacji max 13500cpm (cykli na minutę)   |
| Wyposażenie:  |
| Rozwiertak o przełożeniu 3:1  |
| Wiertarka z uchwytem typu Jacobs wraz z kluczykiem z możliwością mocowania wiertel o średnicy min. 0,0-7,4 mm z przełożeniem 1:1 i kaniulacją 4,2mm |
| Brak kompatybilności z PRO 6200M - System działa niezależnie  |

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław

Al. Wiśniowa 36, 51-137 Wrocław  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

sekretariat (71) 78 90 236  
fax (71) 34 36 747  
centrala (71) 34 27 021 do 025 lub (71) 78 90 200  
kancelaria/fax (71) 360 22 18  
e-mail: szpital\_marciniaka@pro.onet.pl

Sporządziła: Olga Białas  
Sprawdziła: Ewa Kubacka

**2. Pytanie**

*„Pytanie 1 dot. poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękojeści która w celu wydłużenia swojej żywotności oraz funkcjonalności wymaga smarowania przed sterylizacją?”*

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Karcie parametrów” do Zadania 1, stanowiącej integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

**3. Pytanie**

*„Pytanie 2 dot. poz. 3 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękojeści współpracującej tylko z nasadkami o przełożeniach 1:25 i 1:100”*

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Karcie parametrów” do Zadania 1, stanowiącej integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

**4. Pytanie**

*„Pytanie 3 dot. poz. 4 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania piły z głowicą obrotową i maksymalnymi oscylacjami 15000/min?”*

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**5. Pytanie**

*„Pytanie 4 dot. poz. 5 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania baterii bez pojemnika umieszczanych systemem lejkowym w rękojeści urządzenia? W skład zestawu wchodzi lejek do sterylnej wkładania baterii i pokrywa komory baterii.”*

Zamawiający określił w „Karcie parametrów” do Zadania 1, stanowiącej integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza składania ofert równoważnych zgodnie z zapisami pkt. 11.2 SIWZ.

**6. Pytanie**

*„Pytanie 5 dot. poz. 7a Czy Zamawiający miał na myśli nasadkę frezarską AO czy Harris?”*

Zamawiający informuje, że doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia poprzez dopisanie w pozycji 7A „Karty parametrów” do Zadania 1 „...do frezowania panewek do endoprotez...”. Wobec ww. zmiany Zamawiający informuje, że dopuszcza składania ofert równoważnych zgodnie z zapisami pkt. 11.2 SIWZ. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza wszelki asortyment spełniający wymagania Zamawiającego opisane w „Karcie parametrów” stanowiącym integralną część SIWZ.

**7. Pytanie**

*„Pytanie 6 dot. poz. 7b Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nasadki wiertarskiej typu Jacobs z przełożeniem 1:25 współpracującej z wiertłami o średnicy trzpienia od 0,6 do 7,4?”*

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Karcie parametrów” do Zadania 1, stanowiącej integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

**8. Pytanie**

*„Pytanie 7 dot. poz. dodatkowe 2 Czy Zamawiający odstąpi od kompatybilności z posiadanym systemem”*

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Karcie parametrów” do Zadania 1, stanowiącej integralną część SIWZ, swoje wymagania dodatkowe i zapisów tych nie zmienia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że kompatybilność z posiadanym systemem nie jest parametrem wymagany.

**9. Pytanie**

*„Pytanie 8 dot. poz 4a Prosimy o doprecyzowanie czy piła powinna współpracować z ostrzami jednorazowego i wielokrotnego użytku?”*

Zamawiający oczekuje, że piła będzie współpracować z ostrzami jednorazowymi. W związku z powyższym Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zapisów „Karty parametrów” do Zadania 1 w pozycji 4A, mianowicie:

było: *„Ostrza montowane zatrzaskowo w ilość 10 szt. do wyboru z katalogu”*

jest: *„Ostrza jednorazowe montowane zatrzaskowo w ilość 10 szt. do wyboru z katalogu”*

**10. Pytanie**

*„Dot.pkt.2A. Czy Zamawiający dopuści napęd o zakresie obrotów 1200 dla trybu wiercenia oraz 270 w trybie rozwiercania? Zaproponowany napęd wyposażony jest w zmianę momentu obrotowego pokrętkiem na rękojeści.”*

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**11. Pytanie**

*„Dot.pkt.2. Czy Zamawiający dopuści napęd o mocy 240W?”*

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**12. Pytanie**

*„Dot.pkt.2C. Czy Zamawiający uzna za sprzęgło przeciążeniowe wbudowane ograniczenie prądowe spełniające tą samą funkcję?”*

Zamawiający informuje, że uzna za sprzęgło przeciążeniowe wbudowane ograniczenie prądowe spełniające tą samą funkcję.

**13. Pytanie**

*„Dot.pkt.3. Czy Zamawiający dopuści napęd wyposażony w zmianę momentu obrotowego pokrętkiem na rękojeści? Napęd generuje w trybie wiercenia 1200 obrotów oraz odpowiednio 270 obrotów dla rozwiercania. Rozwiązanie to nie wymaga stosowania nasadek redukujących obroty.”*

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**14. Pytanie**

*„Dot.pkt.4. Czy Zamawiający dopuści pilę oscylacyjną z płyną regulacją ruchu oscylacyjnego do 12 000 cykli/min? Rękojeść posiada również dwa tryby pracy szybki 12 000 cykli/min oraz standard 10 000 cykli/min.”*

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**15. Pytanie**

*„Dot.pkt.7A. Czy Zamawiający dopuści nasadkę do wyboru: AO small (mały Synthes), Hudson Modified/Trinkle, Trinkle, AO large (duży Synthes), Synthes DHS/DCS lub modified Trinkle, bez redukcji obrotów? Napęd wyposażony w tryb rozwiercania i wiercenia.”*

Zamawiający informuje, że w pkt 7A wymaga zaoferowania rozwiertaka do frezowania panewek do endoprotez typu Aeskulap o przełożeniu 3:1. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza wszelki asortyment spełniający wymagania Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości złożenia oferty równoważnej, zgodnie z zapisami pkt. 11.2 SIWZ.

**16. Pytanie**

*„Dot.pkt.7B. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nasadki Jacobs z kluczykiem z możliwością montowania wiertła 0-6,35 i kaniulacją min. 4mm?”*

Zamawiający nie wyraża zgody.

**17. Pytanie**

*„Dot.pkt.7B. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania niezależnej rękojeści czy przyznaje jedynie punkty dodatkowe za dwie niezależne napędy i dopuści nasadkę jako rozwiązanie równoważne?”*

Zamawiający domniemywa, że pytanie Wykonawcy odnosi się do parametru dodatkowego dla Zadania 1 wyspecyfikowanego w „Karcie parametrów” w części: „Dodatkowe” pozycja 1. Zamawiający informuje, że punkty dodatkowe zostaną przyznane za zaoferowanie urządzenia posiadającego dwie odrębne pistoletowe rękojeści.

**18. Pytanie**

*„Dot.pkt.7B. Czy jeżeli Zamawiający wymaga zaoferowania w tym punkcie niezależnej rękojeści, dopuści zaoferowanie nasadki Jacobs z kluczykiem z możliwością montowania wiertła 0-6,35 wraz z napędem? Kaniulacja wzdłuż całego zestawu min. 4mm.”*

Zamawiający nie wyraża zgody.

**19. Pytanie**

*„Pytanie 1 dot. zad nr 1*

*Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzeń z kaniulacją o śr max. 4 mm.*

*Zamawiający określił kaniulacje dla nasadki typ Jacobs, nie sprecyzował czy parametr ma dotyczyć kaniulacji przelotowej wszystkich współpracujących ze sobą urządzeń.”*

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Zadanie 2 – Karta parametrów****20. Pytanie**

*„W punkcie nr 7 w/w Załącznika, Zamawiający wymaga:*

*„Natężenie przepływu min. od 0,1-50 ml z regulacją”*

*Czy dopuści do postępowania przetargowego automatyczną strzykawkę charakteryzującą się natężeniem przepływu o poniższych parametrach:*

„Natężenie przepływu 0,1 – 45,0 ml/s z przyrostami co 0,1ml; 0,1 – 59,9ml/m z regulacją co 0,1ml” ?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

#### 21. Pytanie

„W punkcie nr 8 w/w Załącznika, Zamawiający wymaga:

„czas narastania min. od 1 – 90 s z regulacją”

Czy dopuści do postępowania przetargowego automatyczną charakteryzującą się czasem narastania o poniższych parametrach:

„Czas narastania 0 – 9,9 sekund z regulacją co 0,1” ?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu. Jednocześnie Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia, poprzez zmianę zapisów „Karty parametrów” do Zadania 2 w pozycji 9, a mianowicie:**

było: „czas narastania min. od 1- 90s z regulacją”

jest: „czas narastania min. od 1- 9s z regulacją”

#### Zadanie 4

#### 22. Pytanie

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 2: czy Zamawiający dopuści młotek typu Cottle o wadze 240 g, dł. 190 mm? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

#### 23. Pytanie

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 2

Czy zamawiający dopuści młotek o długości 190mm i wadze 240g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

#### 24. Pytanie

„Poz. 2. MŁOTEK typu COTTLE, ŚREDNICA GŁÓWKI 30 MM, WAGA : 235 G, DŁ. 185 MM

Czy zamawiający dopuści : MŁOTEK typu COTTLE, ŚREDNICA GŁÓWKI 30 MM, WAGA : 240 G, DŁ. 190 MM?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

#### 25. Pytanie

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 3: czy Zamawiający dopuści raspator o dł. 180 mm? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

#### 26. Pytanie

„Poz.3. RASPATOR Z UCHWYTEM typu "PEEK", LEKKO WYGIĘTY, SZER. 6 MM, DŁ. 190 MM

Czy zamawiający dopuści : RASPATOR Z UCHWYTEM typu "PEEK", LEKKO WYGIĘTY, SZER. 6 MM, DŁ. 180 MM?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**27. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 16: czy Zamawiający dopuści imadło typu Sarot o dł. 180 mm? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**28. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 4: czy Zamawiający dopuści punch kostny o dł. 200 mm, stopa cienka o szer. 2 mm pod kątem 40°? U różnych producentów występują odmienne sposoby określania kąta wycięcia części pracującej narzędzia i tak 130° określa kąt zewnętrzny, co u naszego producenta odpowiada 40° dla kąta mierzonego od strony wewnętrznej. Pozostałe parametry bez zmian.”

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**29. Pytanie**

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 4

Czy zamawiający dopuści punch o kącie 140 stopni, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**30. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 5: czy Zamawiający dopuści hak typu Richardson rozmiar łyżki 36x28mm? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**31. Pytanie**

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 5

Czy zamawiający dopuści hak o długości 260mm i łyżką o wymiarach 30x28mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**32. Pytanie**

„Poz. 5. HAK OPERACYJNY TYPU RICHARDSON ROZM. ŁYŻKI 30X29 MM, DŁ. 240 MM

Czy zamawiający dopuści : HAK OPERACYJNY TYPU RICHARDSON ROZM. ŁYŻKI 32X29 MM, DŁ. 235 MM?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**33. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 6: czy Zamawiający dopuści hak typu Richardson rozmiar łyżki 28x20mm? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**34. Pytanie**

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 6

Czy zamawiający dopuści hak o długości 260mm i łyżką o wymiarach 28x20mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**35. Pytanie**

„Poz.6. HAK OPERACYJNY TYPU RICHARDSON ROZM. ŁYŻKI 23X20 MM, DŁ. 240 MM

Czy zamawiający dopuści : HAK OPERACYJNY TYPU RICHARDSON ROZM. ŁYŻKI 25X19 MM, DŁ. 235 MM?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**36. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 7: czy Zamawiający dopuści hak typu Richardson rozmiar łyżki 44x38mm? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**37. Pytanie**

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 7

Czy zamawiający dopuści hak o długości 260mm i łyżką o wymiarach 38x38mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**38. Pytanie**

„Poz.7. HAK OPERACYJNY TYPU RICHARDSON ROZM. Łyżki 37 X 37 MM, DŁ. 240 MM

Czy zamawiający dopuści : HAK OPERACYJNY TYPU RICHARDSON ROZM. Łyżki 38 X 38 MM, DŁ. 254 MM?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**39. Pytanie**

„Poz.13. NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYPU TOENNIS- ADSON Z TWARDĄ WKŁADKĄ, ZAGIĘTE, DŁ. 175 MM

Czy zamawiający dopuści : NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYPU METZENBAUM Z TWARDĄ WKŁADKĄ, ZAGIĘTE, DŁ. 180 MM LUB NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYPU TOENNIS- ADSON Z TWARDĄ WKŁADKĄ, ZAGIĘTE, DŁ. 170 MM?”

**Zamawiający dopuszcza nożyczki preparacyjne typu Toennis-Adson z twardą wkładką, zagięte dł. 170 mm.**

**40. Pytanie**

„Poz.14. NOŻYCZKI PREPARACYJNE Z TWARDĄ WKŁADKĄ, TĘPO-TĘPE, ODGIĘTE, DŁ. 115 MM

Czy zamawiający dopuści : NOŻYCZKI PREPARACYJNE Z TWARDĄ WKŁADKĄ TYP IRIS LUB STRABISMUS, TĘPO-TĘPE, ODGIĘTE, DŁ. 115 MM?”

**Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania nożyczek preparacyjnych, z twardą wkładką, tępo-tępych odgiętych o dł. 115 mm, typu numer katalogowy BC257R. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza wszelki asortyment spełniający wymagania Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości złożenia oferty równoważnej, zgodnie z zapisami pkt. 11.2 SIWZ.**

**41. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 15: czy Zamawiający dopuści imadło typu Mayo-Hegar? Pozostałe parametry bez zmian.”

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania imadła chirurgicznego typu Crile-Wood, mocne, szczęki z wgłębieniem ząbkowane krzyżowo, dł. 160 mm typu numer katalogowy BM220R, z uwzględnieniem udzielonych w niniejszym piśmie odpowiedzi na pytania zadane do ww. części przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza wszelki asortyment spełniający wymagania Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości złożenia oferty równoważnej, zgodnie z zapisami pkt. 11.2 SIWZ.

#### 42. Pytanie

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 15

Czy zamawiający dopuści imadło o długości 150mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

#### 43. Pytanie

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 16: czy Zamawiający dopuści imadło typu Sarot, z twardą wkładką, szczęki ząbkowane krzyżowo, dł. 180 mm?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ.**

#### 44. Pytanie

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 16

Czy zamawiający dopuści imadło o długości 180mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

#### 45. Pytanie

„Poz.16. IMADŁO CHIRURGICZNE TYPU SAROT, Z TWARDĄ WKŁADKĄ, SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO CO 0,4 MM (DO IGIEŁ 4/0 - 6/0), DŁ. 175 MM

Czy zamawiający dopuści : IMADŁO CHIRURGICZNE TYPU SAROT, Z TWARDĄ WKŁADKĄ, SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO CO 0,4 MM (DO IGIEŁ 4/0 - 6/0), DŁ. 177 MM?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

#### 46. Pytanie

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 17: czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe typ Micro-Mosquito o dł. 120 mm? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

#### 47. Pytania

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 17

Czy zamawiający dopuści kleszczyki o długości 120mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

#### 48. Pytanie

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 17



Czy zamawiający dopuści kleszczyki o nazwie własnej HALSTED-MOSQUITO i długości 120mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?"

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**49. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 18: czy Zamawiający dopuści spinak do serwet Backhaus o dł. 80 mm?"

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**50. Pytanie**

„Poz. 18. SPINAK DO SERWET TYPU BACKHAUS DŁ. 90 MM

Czy zamawiający dopuści : SPINAK DO SERWET TYPU BACKHAUS DŁ. 80 MM?"

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**51. Pytanie**

„Poz. 19. KLESZCZE Z PRZEKŁADNIĄ BOCZNE DO CIĘCIA DRUTU TYPU KIRSCHNERA DŁ. 235 MM SZCZĘKI ODGIĘTE OSTRZA NAPAWANE TWARDYM METALEM MAKSYMALNA ŚREDNICA DRUTU 2,2 MM

Czy zamawiający dopuści : KLESZCZE Z PRZEKŁADNIĄ BOCZNE DO CIĘCIA DRUTU TYPU KIRSCHNERA DŁ. 210 MM SZCZĘKI ODGIĘTE OSTRZA NAPAWANE TWARDYM METALEM MAKSYMALNA ŚREDNICA DRUTU 2,2 MM?"

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**52. Pytanie**

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 19

Czy zamawiający dopuści kleszcze do drutów o maksymalnej średnicy 2,5mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?"

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**53. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 20: czy Zamawiający dopuści haczyk operacyjny, 1-zębny, ostry, mocno zagięty, dł. 160 mm?"

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**54. Pytanie**

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 20

Czy zamawiający dopuści haczyk o długości 160mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?"

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**55. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 21: czy Zamawiający dopuści haczyk operacyjny, 2-zębny, tępy, mocno zagięty, dł. 160 mm?"

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ.

**56. Pytanie**

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 21

Czy zamawiający dopuści haczyk o długości 160mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**57. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 22 i 44: czy Zamawiający dopuści młotek o wadze 130 g z wymiennymi dyskami z tworzywa, śr. dysków: 35mm, dł. 235 mm?”

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**58. Pytanie**

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 22

Czy zamawiający dopuści młotek o długości 240mm i wadze 230g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**59. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 23: czy Zamawiający dopuści łyżki boczne do rozwieracza typu Millin o wym. 80x25mm?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**60. Pytanie**

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 23

Czy Zamawiający wyłączy daną pozycję do osobnego pakietu, w związku z tym, że łyżki mają być uzupełnieniem dla posiadanego już narzędzia innego producenta lub dopuści zaoferowanie całego narzędzia - rozwieracza MILLIN?”

**Zamawiający wyraża zgodę na proponowany przez Wykonawcę podział Zadania 4. Wydzielona pozycja 23 z dotychczasowego Zadania 4 tworzy Zadanie 10. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.**

**61. Pytanie**

„Poz.23. ŁYŻKI BOCZNE DO ROZWIERACZA TYPU MILLIN O WYM. 82X25 MM

Czy zamawiający dopuści : ŁYŻKI BOCZNE DO ROZWIERACZA TYPU MILLIN O WYM. 80X25 MM?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**62. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 24: czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar o dł. 160 mm? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**63. Pytanie**

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 24

Czy zamawiający dopuści imadło o długości 160mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**64. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 25: czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar, bez złobienia, szer. w części dystalnej: 2,5 mm, dł. 180 mm? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**65. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 25: czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar, bez złobienia, dł. 180 mm?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ.**

**66. Pytanie**

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 25

Czy zamawiający dopuści imadło o długości 200mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**67. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 26: czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne typu Wangensteen o dł. 270 mm?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**68. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 32: czy Zamawiający dopuści wziernik typ Cusco o wymiarach: 100x37 mm?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**69. Pytanie**

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 32

Czy zamawiający dopuści wziernik o wymiarach 110x37mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

**Zamawiający w Zadaniu 4 pozycji 32 wymagał i wymaga zaoferowania wziernika o wymiarach 110x37mm.**

**70. Pytanie**

„Poz.32. WZIERNIK TYPU CUSCO WYMIARY 110X37MM

Czy zamawiający dopuści : WZIERNIK TYPU CUSCO WYMIARY 100X37MM?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**71. Pytanie**

„Poz.35. NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYPU METZENBAUM DELIKATNE, WĄSKIE, ODGIĘTE, DŁ. 145 MM

Czy zamawiający dopuści : NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYPU METZENBAUM-FINO, WĄSKIE, ODGIĘTE, DŁ. 145 MM?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**72. Pytanie**

**„Poz.36. NOŻYCYZKI CHIRURGICZNE STANDARD, PROSTE, TĘPE, DŁ. 145 MM**

**Czy zamawiający dopuści : NOŻYCYZKI CHIRURGICZNE TYP GRAZIL, PROSTE, TĘPE, DŁ. 145 MM?”**

**Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania nożyczek chirurgicznych standard, proste, tępe, dł. 145mm typu numer katalogowy BC314R. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza wszelki asortyment spełniający wymagania Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości złożenia oferty równoważnej, zgodnie z zapisami pkt. 11.2 SIWZ.**

**73. Pytanie**

**„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 37: czy Zamawiający dopuści nożyczki typ Fomon o dł. 135 mm? Pozostałe parametry bez zmian.”**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**74. Pytanie**

**„Poz.37. NOŻYCYZKI PREPARACYJNE TYPU FOMON MOCNO ODGIĘTE DŁ. 115 MM**

**Czy zamawiający dopuści : NOŻYCYZKI PREPARACYJNE TYPU FOMON MOCNO ODGIĘTE DŁ. 135 MM?”**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**75. Pytanie**

**„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 37**

**Czy zamawiający dopuści nożyczki o długości 130mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**76. Pytanie**

**„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 38: czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne typ Converse o dł. 125 mm? Pozostałe parametry bez zmian.”**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**77. Pytanie**

**„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 38: czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne z twardą wkładką typ Converse, nacięcia krzyżowe, dł. 125 mm?”**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ.**

**78. Pytanie**

**„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 38**

**Czy zamawiający dopuści imadło o długości 120mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**79. Pytanie**

**„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 39: czy Zamawiający dopuści nożyczki typ Mayo-Harrington o dł. 225 mm? Pozostałe parametry bez zmian.”**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**80. Pytanie**

„Poz.39. NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYPU MAYO-HARRINGTON,PROSTE, DŁ. 230 MM

Czy zamawiający dopuści : NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYPU MAYO PROSTE, DŁ. 230 MM?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**81. Pytanie**

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 39

Czy zamawiający dopuści nożyczki o nazwie handlowej MAYO, zgodne z parametrami w SIWZ?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**82. Pytanie**

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 40

Czy zamawiający dopuści nożyczki o nazwie handlowej MAYO-NOBLE, zgodne z parametrami w SIWZ?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**83. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 42: czy Zamawiający dopuści pesetę anatomiczną, bagnetową typu Taylor, szer. dystalna: 1,5 mm? Pozostałe parametry bez zmian.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

**84. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 42: czy Zamawiający dopuści pesetę anatomiczną, bagnetową typu Taylor, dł. 175 mm?”

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania pęsety anatomicznej, bagnetowa typu Akson, szer. dystalna: 2,5 mm, dł. 175 mm typu numer katalogowy BD870R, z uwzględnieniem udzielonych w niniejszym piśmie odpowiedzi na pytania zadane do ww. części przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza wszelki asortyment spełniający wymagania Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości złożenia oferty równoważnej, zgodnie z zapisami pkt. 11.2 SIWZ.

**85. Pytanie**

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 42

Czy zamawiający dopuści pęsetę o długości 180mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**86. Pytanie**

„Poz.42. PĘSETA ANATOMICZNA, BAGNETOWA TYPU ADSON, SZER. DYSTALNA: 2,5 MM, DŁ. 175 MM

Czy zamawiający dopuści : PĘSETA ANATOMICZNA, BAGNETOWA BEZ NAZWY WŁASNEJ, SZER. DYSTALNA: 2,5 MM, DŁ. 175 MM?”

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania pęsety anatomicznej, bagnetowa typu Akson, szer. dystalna: 2,5 mm, dł. 175 mm typu numer katalogowy BD870R, z uwzględnieniem udzielonych w niniejszym piśmie odpowiedzi na pytania zadane do ww. części przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego

Zamawiający dopuszcza wszelki asortyment spełniający wymagania Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości złożenia oferty równoważnej, zgodnie z zapisami pkt. 11.2 SIWZ.

**87. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 43: czy Zamawiający dopuści młotek typu Heath o wadze 1000 g, dł. 250 mm? Pozostałe parametry bez zmian.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

**88. Pytanie**

„Poz.43. MŁOTEK TYPU HEATH Z GŁOWICĄ WYPEŁNIONĄ MIEDZIĄ, waga 725 G, ŚR. 45 MM, DŁ. 200 MM

Czy zamawiający dopuści : MŁOTEK TYPU HEATH Z GŁOWICĄ WYPEŁNIONĄ MIEDZIĄ, waga 800 G, ŚR. 40 MM, DŁ. 245 MM?”

Zamawiający nie wyraża zgody.

**89. Pytanie**

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 44

Czy zamawiający dopuści młotek o długości 240mm i wadze 230g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**90. Pytanie**

„Poz.44. MŁOTEK 200 G Z WYMIENNYMI DYSKAMI Z TWORZYWA, ŚR. DYSKÓW: 30 MM, DŁ. 245 MM

Czy zamawiający dopuści : MŁOTEK 370 G Z WYMIENNYMI DYSKAMI Z TWORZYWA, ŚR. DYSKÓW: 37 MM, DŁ. 240 MM?”

Zamawiający nie wyraża zgody.

**91. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 45: czy Zamawiający dopuści kleszcze do trzymania drutu szczęki obustronnie ząbkowane w karo, dł. 140mm?”

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania kleszczy do trzymania drutu typu Marburg, szczęki obustronnie ząbkowane w karo, dł. 140 typu numer katalogowy DP031R. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza wszelki asortyment spełniający wymagania Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości złożenia oferty równoważnej, zgodnie z zapisami pkt. 11.2 SIWZ.

**92. Pytanie**

„Poz.45. KLESZCZE DO TRZYMANIA DRUTU TYPU MARBURG, SZCZĘKI OBUSTRONNIE ZĄBKOWANE W KARO, DŁ. 140 MM

Czy zamawiający dopuści : KLESZCZE DO TRZYMANIA DRUTU TYPU WIRE HOLDING Z ROWKIEM, SZCZĘKI OBUSTRONNIE ZĄBKOWANE W KARO, DŁ. 140 MM?”

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania kleszczy do trzymania drutu typu Marburg, szczęki obustronnie ząbkowane w karo, dł. 140 typu numer katalogowy DP031R. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza wszelki asortyment spełniający wymagania Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości złożenia oferty równoważnej, zgodnie z zapisami pkt. 11.2 SIWZ.

**93. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 46: czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe typ Kocher o dł. 140 lub 160 mm? Pozostałe parametry bez zmian.”

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie wyspecyfikowanych kleszczyków o dł. 160mm, ale nie czyni wymogu.

**94. Pytanie**

„Poz.46. KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU KOCHER, PROSTE 1X2 ZĄBKI, DŁ. 150 MM

Czy zamawiający dopuści : KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU KOCHER, PROSTE 1X2 ZĄBKI, DŁ. 140 MM LUB 160 MM?”

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie wyspecyfikowanych kleszczyków o dł. 160mm, ale nie czyni wymogu.

**95. Pytanie**

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 46

Czy zamawiający dopuści kleszczyki o długości 140mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Zamawiający nie wyraża zgody.

**96. Pytanie**

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 46

Czy zamawiający dopuści kleszczyki o długości 160mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**97. Pytanie**

„Poz.47. IMADŁO CHIRURGICZNE Z PYSZCZKIEM TYPU LAWRENCE , DŁ.150mm

Czy zamawiający dopuści : IMADŁO CHIRURGICZNE Z PYSZCZKIEM TYPU CRILE-MURRAY, DŁ.150mm?”

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania imadła chirurgicznego z pyszczkiem typu Lawrence, dł. 150mm typu numer katalogowy BM221R. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza wszelki asortyment spełniający wymagania Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości złożenia oferty równoważnej, zgodnie z zapisami pkt. 11.2 SIWZ.

**98. Pytanie**

„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 48: czy Zamawiający dopuści nożyczki typu Deaver o dł. 140 mm? Pozostałe parametry bez zmian.”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**99. Pytania**

„Poz.48. NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYPU DEAVER, PROSTE, JEDNO OSTRZE TĘPE, DRUGIE OSTRE, DŁ. 145 MM

Czy zamawiający dopuści : NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYPU DEAVER, PROSTE, JEDNO OSTRZE TĘPE, DRUGIE OSTRE, DŁ. 140 MM?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**100. Pytanie**

*„Poz.49. NOŻYCE DO GIPSU TYPU BERGMANN 230MM*

*Czy zamawiający dopuści : NOŻYCE DO GIPSU TYPU LISTER 200MM LUB NOŻYCE DO GIPSU TYPU SEUTIN 230MM ZE SPRĘŻYNĄ?”*

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania nożyc do gipsu typu Bergmann 230 typu numer katalogowy LX553R. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza wszelki asortyment spełniający wymagania Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości złożenia oferty równoważnej, zgodnie z zapisami pkt. 11.2 SIWZ.

**101. Pytanie**

*„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 50: czy Zamawiający dopuści nożyczki typu Standard o dł. 115 mm? Pozostałe parametry bez zmian.”*

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**102. Pytanie**

*„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 50*

*Czy zamawiający dopuści kleszczyki o długości 115mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”*

Zamawiający domniemywa, że pytanie Wykonawcy odnosi się do nożyczek. W Zadaniu 4 pozycji 50 „Formularza cenowego” Zamawiający wyspecyfikował nożyczki. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nożyczek o długości 115 mm., nie czyniąc wymogu, przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów.

**103. Pytanie**

*„Dotyczy zadania 4, pozycja nr 53: czy Zamawiający dopuści kleszcze typu pean Coller o dł. 190 mm? Pozostałe parametry bez zmian.”*

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**104. Pytanie**

*„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 4, Lp. 53*

*Czy zamawiający dopuści kleszczyki o nazwie handlowej COLLER-CRILE (o kształcie wymaganym przez Zamawiającego), o długości 180mm?”*

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kleszczy o dł. 180mm, z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów. Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania kleszczy typu Pean Coller proste, dł. 185 mm typu numer katalogowy MD468 z uwzględnieniem udzielonych w niniejszym piśmie odpowiedzi na pytania zadane do ww. części przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza wszelki asortyment spełniający wymagania Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości złożenia oferty równoważnej, zgodnie z zapisami pkt. 11.2 SIWZ.

**105. Pytanie**

*„Poz.53. KLESZCZE TYPU PEAN COLLER PROSTE, dł.185 mm*

*Czy zamawiający dopuści : KLESZCZE TYPU PEAN DELICATE PROSTE, dł.180 mm?”*



Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kleszczy o dł. 180mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów. Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania kleszczy typu Pean Coller proste, dł. 185 mm typu numer katalogowy MD468 z uwzględnieniem udzielonych w niniejszym piśmie odpowiedzi na pytania zadane do ww. części przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza wszelki asortyment spełniający wymagania Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości złożenia oferty równoważnej, zgodnie z zapisami pkt. 11.2 SIWZ.

#### Zadanie 5

##### 106. Pytanie

„Dotyczy zadania 5, pozycja nr 1: czy Zamawiający dopuści haczyk do artroskopii śr. 2,5mm lub 3,5mm, rączka trójkątna? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

##### 107. Pytanie

„Dotyczy zadania 5, pozycja nr 2: czy Zamawiający dopuści punch artroskopowy, część robocza prostokątna, wysokość dolnej szczęki 1,6 mm, wysokość całkowita szczęki 2,3 mm, dł. robocza trzonu 12,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

##### 108. Pytanie

„Dotyczy zadania 5, pozycja nr 3: czy Zamawiający dopuści punch artroskopowy, część robocza prostokątna, wysokość dolnej szczęki 1,6 mm, wysokość całkowita szczęki 2,3 mm, dł. robocza trzonu 12,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**


##### 109. Pytanie

„Dotyczy zadania 5, pozycja nr 4: czy Zamawiający dopuści punch artroskopowy, część robocza prostokątna, dł. robocza trzonu 12,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

##### 110. Pytanie

„Dotyczy zadania 5, pozycja nr 5: czy Zamawiający dopuści kleszcze artroskopowe dedykowane do łękotki, dł. robocza trzonu 13 cm, bez śruby blokującej, rękojeść wg poniższej ilustracji? Pozostałe parametry bez zmian.”

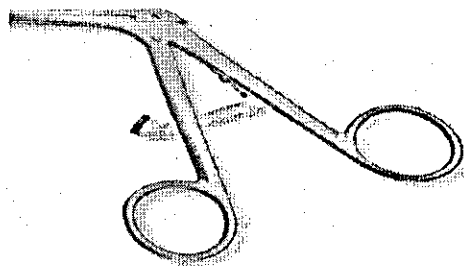

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**111.Pytanie**

„Dotyczy zadania 5, pozycja nr 6: czy Zamawiający dopuści kleszcze artroskopowe, chwytne, śr. 3,4 mm? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**112.Pytanie**

„Dotyczy zadania 5, pozycja nr 7: czy Zamawiający dopuści kleszcze artroskopowe, chwytно-biopsyjne, śr. 3,3 mm, dł. robocza trzonu 12,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**113.Pytanie**

„Dotyczy zadania 5, pozycja nr 8: czy Zamawiający dopuści kleszcze artroskopowe, chwytne, dł. robocza trzonu 12,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**114.Pytanie**

„Dotyczy zadania 5, pozycja nr 9: czy Zamawiający dopuści punch artroskopowy, owalny, część robocza owalna, wysokość dolnej szczęki 2,3 mm, wysokość całkowita szczęki 3,3 mm, dł. robocza trzonu 12,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**115.Pytanie**

„Dotyczy zadania 5, pozycja nr 10: czy Zamawiający dopuści punch artroskopowy, część robocza prostokątna, wysokość dolnej szczęki 2,6 mm, wysokość całkowita szczęki 3,0 mm, dł. robocza trzonu 12,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**116.Pytanie**

„Dotyczy zadania 5, pozycja nr 11: czy Zamawiający dopuści kleszcze artroskopowe, chwytne, wysokość całkowita szczęki 3,75 mm, dł. robocza trzonu 12,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**117.Pytanie**

„Dotyczy zadania 5, pozycja nr 12: czy Zamawiający dopuści nożyczki artroskopowe typu Punch, wysokość dolnej szczęki 2,3 mm, wysokość całkowita szczęki 2,5 mm, dł. robocza trzonu 12,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zadanie 6****118.Pytanie**

„Poz.2. ŚRUBOKRĘT FI 6MM ZE SZTUCZNĄ RĘKOJEŚCIĄ 25CM

Czy zamawiający dopuści : ŚRUBOKRĘT FI 6MM ZE SZTUCZNĄ RĘKOJEŚCIĄ 22CM?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**Zadanie 9****119. Pytanie**

„Czy Zamawiający w pozycjach nr 1, 2, 5, 6, 16 dopuści tolerancję długości +/- 0,5mm?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ.

**120. Pytanie**

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 9, Lp. 2

Czy zamawiający dopuści nożyczki o długości 150mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**121. Pytanie**

„Poz.2. Nożyczki typu Mayo-Stille, proste, tępo-tępe, dł. 14,5 cm

Czy zamawiający dopuści : Nożyczki typu Mayo-Stille, proste, tępo-tępe, dł. 15 cm?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**122. Pytanie**

„Poz.3. Pęseta typu Brophy, anatomiczna, prosta, z bolcem naprowadzającym, dł. 20 cm

Czy zamawiający dopuści : Pęseta bez nazwy własnej, anatomiczna, prosta, z bolcem naprowadzającym, dł. 17,4 cm?”

Zamawiający nie wyraża zgody.

**123. Pytanie**

„Czy Zamawiający w punkcie 4 dopuści pęsetę anatomiczną prostą z bolcem naprowadzającym, dł. 20cm typu Cushing?”

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania pęsety typu Waugh, anatomiczna, prosta, z bolcem naprowadzającym, dł. 20cm typu numer katalogowy 020-130-20. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza wszelki asortyment spełniający wymagania Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości złożenia oferty równoważnej, zgodnie z zapisami pkt. 11.2 SIWZ.

**124. Pytanie**

„Czy Zamawiający w punkcie 9 dopuści retraktor typu Kocher-Langebeck z zachowaniem pozostałych parametrów wymaganych?”

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania retraktora do ran typu Langenbeck, rączka ażurowa, wym.25x6mm, dł. 21,5 cm typu numer katalogowy RU 4538-11. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza wszelki asortyment spełniający wymagania Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości złożenia oferty równoważnej, zgodnie z zapisami pkt. 11.2 SIWZ.

**125. Pytanie**

„Czy Zamawiający w punkcie 11 dopuści kleszcze typu Pean proste o dł. 14cm?”

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania kleszczy typu Pean Delicate, proste, dł. 14 cm typu numer katalogowy 040-262-14. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza wszelki asortyment

spełniający wymagania Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości złożenia oferty równoważnej, zgodnie z zapisami pkt. 11.2 SIWZ.

#### 126. Pytanie

„dotyczy: Formularz cenowy, Zadanie 9, Lp. 11

Czy zamawiający dopuści kleszczyki o nazwie handlowej PEAN FINE, zgodny z zapisami w SIWZ?”

Zamawiający informuje, że wymaga zaferowania kleszczy typu Pean Delicate, proste, dł. 14 cm typu numer katalogowy 040-262-14. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza wszelki asortyment spełniający wymagania Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości złożenia oferty równoważnej, zgodnie z zapisami pkt. 11.2 SIWZ.

#### 127. Pytanie

„Poz.12. Imadło do szycia typu Mayo Hegar, proste, bransza złobiona, fakturowana krzyżowo, dł. 16 cm

Czy zamawiający dopuści : Imadło do szycia typu Mayo Hegar, proste, bransza złobiona, fakturowana krzyżowo, dł. 15,2 cm lub 18 cm?”

Zamawiający informuje, że dopuści zaferowanie wyspecyfikowanego imadła o dł. 15,2cm, ale nie czyni wymogu.

#### 128. Pytanie

„Czy Zamawiający w pozycjach nr 12, 13 dopuści tolerancję długości +/- 1,0mm?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ.

#### 129. Pytanie

„Czy Zamawiający w punkcie 13 dopuści imadło o długości 15cm?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ.

#### 130. Pytanie

„Poz.13. Imadło typu Hegar, proste, masywny kształt, bransza złobiona i fakturowana krzyżowo, dł. 16cm

Czy zamawiający dopuści : Imadło typu Hegar, proste, masywny kształt, bransza złobiona i fakturowana krzyżowo, dł. 15,2 cm lub 18 cm?”

Zamawiający informuje, że dopuści długość 15,2cm.

#### 131. Pytanie

„Dotyczy zadania 9, pozycja nr 14: czy Zamawiający dopuści młotek neurologiczny typu Babinsky z igłą, długość 22 cm?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

#### 132. Pytanie

„Poz.14. Młotek neurologiczny typu Babinsky z igłą, długość 24 cm.

Czy zamawiający dopuści : Młotek neurologiczny typu Babinsky z igłą, długość 23 cm lub 25 cm?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**133. Pytanie**

*„Czy Zamawiający wyłączy z pakietu pozycję nr 14?”*

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany przez Wykonawcę podział Zadania 9. Wydzielona pozycja 14 z dotychczasowego Zadania 9 tworzy Zadanie 11. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.

**134. Pytanie**

*„Poz. 15. Hak skórny typu Gillies, duży, fig.2, dł. 18 cm*

*Czy zamawiający dopuści : Hak skórny typu Gillies, duży, fig.2, dł. 18 cm tępy?”*

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania haka skórny typu Gillies, duży, fig.2, dł. 18 cm typu numer katalogowy RU 6296-01. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza wszelki asortyment spełniający wymagania Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości złożenia oferty równoważnej, zgodnie z zapisami pkt. 11.2 SIWZ.

**135. Pytanie**

*„Czy Zamawiający w punkcie 23 dopuści nożyczki preparacyjne typu Toennis Adson tępe, zakrzywione, o długości 17,5 cm?”*

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ.

**136. Pytanie**

*„Dotyczy zadania 9, pozycja nr 23: czy Zamawiający dopuści nożyczki typu Toennis Adson o dł. 17,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.”*

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu, z uwzględnieniem zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie 137.

**137. Pytanie**

*„Poz.23. Nożyczki preparacyjne typu Toennis Adson, tępe, zakrzywione, bransza ząbkowana typu Super Cut, ucha i rękojeści czernione, dł. 17,5cm.*

*Czy zamawiający dopuści : Nożyczki preparacyjne typu Toennis Adson, tępe, zakrzywione, dł. 17,5cm?*

*Analizując symbol RU1825-17M, nożyczki również nie posiadają czernionego ucha i rękojeści.”*

Zamawiający informuje, że zmienia opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu 9 w pozycji 23 poprzez wykreślenie „...typu numer katalogowy RU1825-17M” w kolumnie nr 2 „Formularza cenowego”. Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu z uwzględnieniem ww. zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

**Zapisy SIWZ**

**138. Pytanie**

*„Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający wyjaśnił, które z zastosowanych, przykładowych numerów katalogowych (Pakiety 4-9), pochodzą z materiałów informacyjnych którego producenta. Pozwoli to na zaoferowanie narzędzi w pełni odpowiadających wymaganiom Zamawiającego.”*

Zamawiający informuje, że przykładowe kody katalogowe podane w Zadaniach 4-9 pochodzą z materiałów informacyjnych: w zadaniu 4 – Aesculap, w Zadaniu 5 – Rudolf, w Zadaniu 6 – Martin, w Zadaniu 7 - Beryl, w Zadaniu 8 - RZ Medicine Technik, w Zadaniu 9: pozycje 1-2, 9, 12-23 – Rudolf, pozycje 3-8 oraz 10-11 Martin.

#### 139. Pytanie

„Dotyczy Zadań 4, 5, 6, 9

Siedziba większości firm wytwarzających narzędzia chirurgiczne mieści się w Niemczech w regionie Badenii Wittenbergi. Zasadą przestrzeganą od lat jest, że cały ten region ma okres wakacyjny w miesiącu sierpniu. Jest to również czas przerwy technicznej służącej kontroli, regeneracji i kalibracji maszyn. W tym roku termin ten przypada na okres 10-28 sierpnia. W związku z tym większość firm oferujących narzędzia chirurgiczne nie będzie w stanie wystartować w wyżej wymienionym przetargu, gdyż nie będzie możliwe dostarczenie przedmiotu zamówienia nawet w ciągu 28 dni.

Uprzejmie prosimy zatem o wydłużenie terminu do standardowych 6 tygodni od daty podpisania umowy.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### Wzory umowy

#### 140. Pytanie

„Dotyczy wzoru umowy nr 1:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.**
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości **brutto niezrealizowanej części** umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.**”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.

#### 141. Pytanie

Dotyczy wzoru umowy nr 2:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.**
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości **brutto niezrealizowanej części** umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.**”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.

**142. Pytanie**

„Czy Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy, w zakresie pkt. 3, 4 § 1 o treści (cyt.)?:

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie fabrycznie nowy przedmiot umowy środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie .... dni (dla Zadania 1 – 14 dni; dla Zadania 2 – 28 dni) od daty otrzymania zamówienia.

4. Strony uznają faks za obowiązujący dokument zamówienia.

i nada mu proponowane brzmienie:

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowy przedmiot umowy, środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny, w terminie do ... dni (dla Zadania 1 – 14 dni; dla Zadania 2 – 28 dni) od daty obustronnego podpisania umowy.

4. do wykreślenia w całości

Uzasadnienie:

Przedmiotem umowy jest jednorazowa dostawa sprzętu medycznego, w związku z czym proponowana modyfikacja zapisów umowy naszym zdaniem jest uzasadniona i w pełni zabezpiecza terminową realizację przedmiotu umowy, zgodnie z terminami sprecyzowanym dla Zadań nr 1 i 2.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia, okres zawarcia dla ww. umowy to 6 miesięcy i Zamawiający zamierza w tym okresie złożyć zamówienie na dostawę aparatury medycznej.

**143. Pytanie**

„Czy Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy, w zakresie pkt. 4, 5 § 4 o treści (cyt.)?:

1. Wykonawca zapewnia przyjazd serwisu w ciągu 24 godzin po zgłoszeniu usterki, awarii lub innej nieprawidłowości. Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 3 dni. Po przekroczeniu powyższego terminu Wykonawca przedłuża gwarancję na dany towar na czas przerwy w eksploatacji. W razie usuwania usterki, awarii lub innej nieprawidłowości trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zapewnia wstawienie sprzętu zastępczego wolnego od wad.

2. W przypadku powtarzających się napraw, w ilości powyżej 3 napraw tego samego zespołu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy w terminie 14 dni od pisemnego potwierdzenia przez serwis o konieczności 4 naprawy tego samego zespołu.”

i nada mu proponowane brzmienie:

4. Wykonawca zapewnia przyjazd serwisu w ciągu 48 godzin po zgłoszeniu usterki, awarii lub innej nieprawidłowości. Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni. Po przekroczeniu powyższego terminu Wykonawca przedłuża gwarancje na dany towar na czas przerwy w eksploatacji. W razie usuwania usterki, awarii lub innej nieprawidłowości trwającej dłużej niż 7 dni Wykonawca zapewnia wstawienie sprzętu zastępczego wolnego od wad.

5. W przypadku powtarzających się napraw, w ilości powyżej 3 napraw tego samego zespołu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy w terminie 30 dni od pisemnego potwierdzenia przez autoryzowany serwis producenta urządzenia o konieczności 4 (czwartej) naprawy tego samego zespołu.

Uzasadnienie:

Proponowane przez nas terminy są jedynymi realnymi terminami, jeśli chodzi o możliwości działań serwisu, przede wszystkim w zakresie potencjalnie możliwych napraw, do ukończenia których niezbędne będą części zamienne sprowadzane od producenta urządzenia (np. w przypadku Zadania 2 – transport z Holandii)."

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.**

**144. Pytanie**

„Czy Zamawiający wykreśli ze wzoru umowy pkt. 1 § 5 o treści (cyt.)?:

„1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ..... do ..... r.”

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa wstrzykiwacza kontrastu objętego w dniu instalacji 24 miesięczną gwarancją. Pozostawienie w/w zapisu w umowie powodować może błędne przypuszczenie, iż przedmiotem umowy nie jest jednorazowa dostawa urządzenia medycznego i objęcie go 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym ale chodzić może o dzierżawę lub leasing.”

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.**

**145. Pytanie**

„Czy Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy, w zakresie pkt. 2 – 5 § 6 o treści (cyt.)?:

2. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.
3. Jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie – zapłaci wówczas Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
4. Zamawiający może uznać za przerwanie wykonywania przez Wykonawcę umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zamówienia dłużej niż 2 dni od terminu określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.
5. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

i nada mu proponowane brzmienie:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.
3. Jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie – zapłaci wówczas Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
4. Zamawiający może uznać za przerwanie wykonywania przez Wykonawcę umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zamówienia dłużej niż 3 dni od terminu określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, po wcześniejszym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji zamówienia.



5. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Uzasadnienie:

Proponowany przez Zamawiającego poziom kar jest zbyt wygórowany, w związku z czym wnioskujemy o ich obniżenie."

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.**

W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

- zmianę brzmienia zapisów „Karty parametrów” do Zadania 1 poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 4A, który otrzymuje brzmienie: **„Ostrza jednorazowe montowane zatraskowo w ilość 10 szt. do wyboru z katalogu”;**

- zmianę brzmienia zapisów „Karty parametrów” do Zadania 1 poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 7A, który otrzymuje brzmienie: **„Rozwiertak do frezowania panewek do endoprotez typu Aeskulap o przełożeniu 3:1”;**

- zmianę brzmienia zapisów „Karty parametrów” do Zadania 2 poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 8, który otrzymuje brzmienie: **„czas narastania min. od 1- 9s z regulacją”;**

- zmianę brzmienia zapisów „Formularza cenowego” do Zadania 9 poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 23, który otrzymuje brzmienie: **„Nożyczki preparacyjne typu Toennis Adson, tępe, zakrzywione, bransza ząbkowana typu Super Cut, ucha i rękojeści czernione, dł. 17,5cm.”;**

- zmiany podziału przedmiotu zamówienia poprzez dodanie części przedmiotu zamówienia tj.: **Zadanie 10, Zadanie 11** w punkcie 1.1 SIWZ i „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ;

- zmianę brzmienia zapisów SIWZ w Części B pkt. 3.1. lit. c) oraz pkt. 12.1. lit. j), który otrzymuje brzmienie: **„oświadczenie, potwierdzające że oferowany asortyment jest identyfikowany za pomocą systemu Data Matrix (dotyczy Zadań 4-11)”**

- zmianę brzmienia zapisów SIWZ w Części B pkt. 5.1., który otrzymuje brzmienie: **„Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:**

**Zadanie 1 – 700,00 złotych,**

**Zadanie 2 – 1 900,00 złotych,**

**Zadanie 3 – 288,00 złotych,**

**Zadanie 4 – 1 387,00 złotych,**

**Zadanie 5 – 663,00 złotych**

**Zadanie 6 – 69,00 złotych**

**Zadanie 7 – 51,00 złotych**

**Zadanie 8 – 340,00 złotych**

Zadanie 9 – 382,00 złotych

Zadanie 10 – 3,00 złotych

Zadanie 11 – 9,00 złotych

Łączna wysokość wadium: 5 792,00 złote.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.”;

- zmianę brzmienia zapisów SIWZ w Części B pkt. 20.1.B., który otrzymuje brzmienie:

„Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami (dotyczy Zadania 3-11):

| Lp. | Kryteria (K)    | Ranga (R)<br>% |
|-----|-----------------|----------------|
| 1   | Cena            | 80,00          |
| 2   | Termin dostawy  | 20,00          |
|     | <b>OGÓŁEM :</b> | <b>100,00</b>  |

ad.1. Wartość punktowa ceny wyliczona zostanie wg wzoru:

$$\frac{\text{cena minimalna}}{\text{cena oferowana}} \times R$$

ad. 2. Termin dostawy należy podać w punkcie 6 „Oferty Wykonawcy”, która stanowi integralną część niniejszej SIWZ. Wykonawca może wpisać w ww. punkcie „Oferty Wykonawcy” wyłącznie:

- 7 dni lub 14 dni dla Zadania 3

- 14 dni lub 28 dni dla Zadań 4-11

Za termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma odpowiednio:

- 20,00 pkt za 7 dni, 0,00 pkt za 14 dni dla Zadania 3,

- 20,00 pkt za 14 dni, 0,00 pkt za 28 dni dla Zadań 4-11.

Zamawiający nie przewiduje możliwości wpisania przez Wykonawcę innych terminów dostawy niż jeden z wyżej wymienionych.

Maksymalny termin dostawy wymagany przez Zamawiającego, to 14 dni dla Zadania 3 i 28 dni dla Zadań 4-11. Wykonawca nie otrzyma punktów dodatkowych za nieprawidłowe wypełnienie punktu 6 „Oferty Wykonawcy”, stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku podania terminu dostawy dłuższego niż 14 dni dla Zadania 3 i dłuższego niż 28 dni dla Zadań 4-11 oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. W przypadku nie wypełnienia pkt. 6 „Oferty Wykonawcy”, Zamawiający uzna, że oferowany termin dostawy to 14 dni dla Zadania 3 i 28 dni dla Zadań 4-11.

Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.”

- zmianę brzmienia zapisów wzoru II umowy – zmiana zapisu w § 1 ust. 3 ww. wzoru umowy poprzez zmianę zapisu:

było: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie .... dni (dla Zadania 3 – 7 dni – 20,00 pkt/ 14 dni – 0,00 pkt dla Zadań 4-9: 14 dni – 20,00 pkt/ 28 dni – 0,00 pkt) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia”

jest: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie .... dni (dla Zadania 3 – 7 dni – 20,00 pkt/ 14 dni – 0,00 pkt dla Zadań 4-11: 14 dni – 20,00 pkt/ 28 dni – 0,00 pkt) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia”;

- zmianę brzmienia zapisów wzoru II umowy – zmiana zapisu w § 5 ust. 2 ww. wzoru umowy poprzez zmianę zapisu:

było: „Gwarancję ustala się na okres ..... (12 miesięcy dla Zadania 3 / 24 miesiące dla Zadań 4-9) od dnia dokonania odbioru”

jest: „Gwarancję ustala się na okres ..... (12 miesięcy dla Zadania 3 / 24 miesiące dla Zadań 4-11) od dnia dokonania odbioru”;

- zmianę brzmienia zapisów „Oferty Wykonawcy” poprzez zmianę zapisów pkt 5 i 6:

było: 5. Gwarancję na przedmiot zamówienia ustalamy na okres 24 miesięcy (dotyczy Zadań 1-2, Zadań 4-9) / 12 miesięcy (dotyczy Zadania 3) liczony od dnia dokonania odbioru.

6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar, środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie do ..... dni (dla Zadania 3 – 7 dni – 20,00 pkt/ 14 dni – 0,00 pkt; dla Zadań 4-9: 14 dni – 20,00 pkt/ 28 dni – 0,00 pkt) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia.

było: 5. Gwarancję na przedmiot zamówienia ustalamy na okres 24 miesięcy (dotyczy Zadań 1-2, Zadań 4-11) / 12 miesięcy (dotyczy Zadania 3) liczony od dnia dokonania odbioru.

6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar, środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie do ..... dni (dla Zadania 3 – 7 dni – 20,00 pkt/ 14 dni – 0,00 pkt; dla Zadań 4-11: 14 dni – 20,00 pkt/ 28 dni – 0,00 pkt) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia.

Wobec powyższych zmian dokonanych w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z równoczesnym zastosowaniem art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy. W oparciu o art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 18.08.2015r., godziny i miejsca pozostają bez zmian.

W załączeniu „Formularz cenowy”, „Karty parametrów”, wzór II umowy, „Oferta Wykonawcy” i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia uwzględniające powyższe zmiany. Jednocześnie Zamawiający przypomina o zapisie pkt. 12.11. SIWZ.

Zamawiający informuje, że w dniu 14.08.2015r. Administracja Szpitala będzie nieczynna.

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych  
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

Pełna nazwa Wykonawcy .....

Adres (siedziba) Wykonawcy .....

## OFERTA WYKONAWCY

1. Oferujemy dostawę narzędzi i aparatury medycznej:

|               |                      |               |
|---------------|----------------------|---------------|
| Zadanie ..... | wartość netto .....  | /100zł zł*    |
|               | (słownie: .....      | ...../100zł)* |
|               | kwota VAT .....      | /100zł zł*    |
|               | (słownie: .....      | ...../100zł)* |
|               | wartość brutto ..... | /100zł zł*    |
|               | (słownie: .....      | ...../100zł)* |

itd.

Wartość brutto powinna zawierać wartość netto, kwotę podatku VAT, cenę transportu, upusty, rabaty oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z całością dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z aktualnymi wzorami stanowiącymi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Numer faksu pod który Zamawiający będzie wysyłał wnioski, zawiadomienia oraz informacje ..... Brak wypełnienia oznaczać będzie, że Zamawiający prześle ww. korespondencję na numer faksu podany w ofercie.
4. Za wykonanie przedmiotu umowy wymagać będziemy zapłaty w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto bankowe. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się podać numer powyższego konta bankowego.
5. Gwarancję na przedmiot zamówienia ustalamy na okres 24 miesięcy (dotyczy Zadań 1-2, Zadań 4-11) / 12 miesięcy (dotyczy Zadania 3) liczony od dnia dokonania odbioru.
6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar, środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie do ..... dni (dla Zadania 3 – 7 dni – 20,00 pkt/ 14 dni – 0,00 pkt; dla Zadań 4-11: 14 dni – 20,00 pkt/ 28 dni – 0,00 pkt) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia.
7. Oświadczamy, że zobowiązujemy się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar, środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie do 14 dni (dotyczy Zadania 1) / 28 dni (dotyczy Zadania 2) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia.
8. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć część wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - ..... (należy wskazać część). Brak wypełnienia oznaczać będzie, że Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.
9. W Naszym imieniu serwis gwarancyjny prowadzi ..... (dotyczy Zadania 1 i Zadania 2 „Formularza Cenowego”\*\*\*\*).
10. Wadium w kwocie ..... zostało uiszczzone w dniu ..... w formie ..... Dowód wpłaty dołączamy do oferty.
11. W wypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w ustalonym terminie po otrzymaniu informacji akceptującej\*\*:  
 - w siedzibie Zamawiającego,  
 - na własną odpowiedzialność w swojej siedzibie, i odesłaniu w ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania, po\*\*:  
     > przesłaniu pocztą priorytetową,  
     > przesłaniu pocztą kurierską ..... (nr klienta ..... ) na koszt własny,  
     > odebraniu jej przez przedstawiciela firmy.
9. Nasz numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium\*\*\*.....  
 W przypadku braku wypełnienia Zamawiający zwróci wadium na numer konta, z którego dokonano jego przelewu.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-420 Wrocław ul. Traugutta 116  
tel. 71 342 76 01, fax 071/343-67-47

.....  
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)

\* Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

\*\* Niepotrzebne skreślić

\*\*\* Wypełnić w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza

\*\*\*\* Brak wypełnienia oznaczać będzie, że Wykonawca będzie wykonywał serwis samodzielnie

03

## FORMULARZ CENOWY

| Lp.                | Opis wyrobu   | nazwa handlowa,<br>nr katalogowy | j.m. | ilość | Cena j.<br>netto | VAT % | Kwota j.<br>VAT | Cena j.<br>brutto | wartość<br>netto | kwota<br>VAT | wartość<br>brutto | Producent/<br>uwagi | strony oferty z<br>opisem<br>katalogowym |
|--------------------|---|----------------------------------|------|-------|------------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------|--|
| 1                  | 2   | 3                                | 4    | 5     | 6                | 7     | 8               | 9                 | 10               | 11           | 12                | 13                  | 14                                       |
| -                  | -   | -                                | -    | -     | -                | -     | [6x7]           | [6+8]             | [5x6]            | [5x8]        | [5x9]             | -                   | -  |
| <b>ZADANIE 1</b>   |   |                                  |      |       |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 1                  | Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich i oraz piły oscylacyjnej wg Karty parametrów#   |                                  |      |       |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| <b>ZADANIE 2</b>   |   |                                  |      |       |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 1                  | Wstrzykiwacz automatyczny wg Karty parametrów#  |                                  |      |       |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| <b>ZADANIE 3</b>   |   |                                  |      |       |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 1                  | Inzektor, regulator ssania umożliwiający płynną regulację i pomiar wytworzonego ciśnienia ze sprężonego powietrza, w zakresie min. od 0 do 760mmHg, wyposażony w manometr i zawór szybkiego otwierania. Podłączany bezpośrednio do gniazda typu AGA |                                  |      |       |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| <b>ZADANIE 4**</b> |   |                                  |      |       |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 1                  | RAMIE MOCUJACE typu YASARGIL, PRZESTAWIALNE   | typu numer katalogowy FF270R     | szt. | 2     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 2                  | MŁOTEK typu COTTLE, ŚREDNICA GŁÓWKI 30 MM, WAGA : 235 G, DŁ. 185 MM   | typu numer katalogowy FL038R     | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 3                  | RASPATOR Z UCHWYTEM typu "PEEK", LEKKO WYGIĘTY, SZER. 6 MM, DŁ. 190 MM  | typu numer katalogowy FK319R     | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 4                  | PUNCH KOSTNY typu KERRISON, STOPA CIENKA O SZER. 2 MM pod kątem 130 stopni, ROZBIERALNY, BEZ EJEKTORA, DŁ. 230 MM.  | typu numer katalogowy FK925R     | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 5                  | HAK OPERACYJNY TYPU RICHARDSON ROZM. ŁYŻKI 30X29 MM, DŁ. 240 MM   | typu numer katalogowy BT476      | szt. | 11    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 6                  | HAK OPERACYJNY TYPU RICHARDSON ROZM. ŁYŻKI 23X20 MM, DŁ. 240 MM   | typu numer katalogowy BT475      | szt. | 6     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 7                  | HAK OPERACYJNY TYPU RICHARDSON ROZM. ŁYŻKI 37 X 37 MM, DŁ. 240 MM   | typu numer katalogowy BT477      | szt. | 6     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 8                  | NOŻYCE DO GIPSU TYPU ESMARCH, DŁ. 200 MM  | typu numer katalogowy LX550R     | szt. | 2     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 9                  | NOŻYCKI OPATRUNKOWE Z KULKĄ TYPU LISTER. DŁ. 180MM  | typu numer katalogowy BC862R     | szt. | 2     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 10                 | PINCETA ANATOMICZNA, ŚREDNIO-SZEROKA, DŁ. 145MM   | typu numer katalogowy BD027R     | szt. | 10    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 11                 | UCHWYT SKALPELA NR 3 (TRZONEK) DŁ. 125MM  | typu numer katalogowy BB073R     | szt. | 5     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 12                 | UCHWYT SKALPELA NR 4 (TRZONEK) DŁ. 135MM  | typu numer katalogowy BB084R     | szt. | 2     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |

Dochołski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-420 Wrocław, ul. Traugutta 116  
tel. 343-76-01 fax 071/343-67-47

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Opis wyrobu   | nazwa handlowa,<br>nr katalogowy | j.m. | ilość | Cena j.<br>netto | VAT % | Kwota j.<br>VAT | Cena j.<br>brutto | wartość<br>netto | kwota<br>VAT | wartość<br>brutto | Producent/<br>uwagi | strony oferty z<br>opisem<br>katalogowym |
|-----|---|----------------------------------|------|-------|------------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------|--|
| 1   | 2   | 3                                | 4    | 5     | 6                | 7     | 8               | 9                 | 10               | 11           | 12                | 13                  | 14                                       |
| -   | -   | -                                | -    | -     | -                | -     | [6*7]           | [6+8]             | [5*6]            | [5*8]        | [5*9]             | -                   | -  |
| 13  | NOŻYCKI PREPARACYJNE TYPU<br>TOENNIS-ADSON Z TWARDĄ WKŁADKĄ,<br>ZAGIĘTE, DŁ. 175 MM   | typu numer katalogowy<br>BC273R  | szt. | 5     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 14  | NOŻYCKI PREPARACYJNE Z TWARDĄ<br>WKŁADKĄ, TĘPO-TĘPE, ODGIĘTE, DŁ. 115<br>MM   | typu numer katalogowy<br>BC257R  | szt. | 6     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 15  | IMADŁO CHIRURGICZNE TYPU CRILE-<br>WOOD, MOCNE, SZCZĘKI Z WGLĘBIENIEM<br>ZABKOWANE KRZYŻOWO, DŁ. 160 MM   | typu numer katalogowy<br>BM220R  | szt. | 6     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 16  | IMADŁO CHIRURGICZNE TYPU SAROT, Z<br>TWARDĄ WKŁADKĄ, SZCZĘKI<br>ZABKOWANE KRZYŻOWO CO 0.4 MM (DO<br>IGIEŁ 4/0 - 6/0), DŁ. 175 MM                                    | typu numer katalogowy<br>BM020R  | szt. | 3     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 17  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE<br>TYPU MICRO-HALSTED, BEZ ZĄBKA,<br>PROSTE DŁ. 125 MM  | typu numer katalogowy<br>BH108R  | szt. | 30    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 18  | SPINAK DO SERWET TYPU BACKHAUS DŁ.<br>90 MM   | typu numer katalogowy<br>BF431R  | szt. | 20    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 19  | KLESZCZE Z PRZEKŁADNIĄ BOCZNE DO<br>CIĘCIA DRUTU TYPU KIRSCHNERA DŁ. 235<br>MM SZCZĘKI ODGIĘTE OSTRZA<br>NAPAWANE TWARDEMETALEM<br>MAKSYMALNA ŚREDNICA DRUTU 2,2 MM | typu numer katalogowy<br>LX157R  | szt. | 5     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 20  | HACZYK OPERACYJNY, 1-ZĘBNY, OSTRY,<br>MOCNO ZAGIĘTY, (GŁĘBOKOŚĆ: 5 MM),<br>DŁ. 165MM  | typu numer katalogowy<br>BT111R  | szt. | 4     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 21  | HACZYK OPERACYJNY, 2-ZĘBNY, TĘPY,<br>MOCNO ZAGIĘTY (4,5 X 4,2 MM), DŁ. 165<br>MM  | typu numer katalogowy<br>BT117R  | szt. | 6     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 22  | MŁOTEK waga 200 G Z WYMIENNYMI<br>DYSKAMI Z TWORZYWA, ŚR. DYSKÓW: 30<br>MM, DŁ. 245 MM  | typu numer katalogowy<br>FL045R  | szt. | 2     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 24  | IMADŁO CHIRURGICZNE TYPU MAYO-<br>HEGAR, BEZ ŻŁOBNIENIA, DŁ. 165 MM   | typu numer katalogowy<br>BM241R  | szt. | 20    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 25  | IMADŁO CHIRURGICZNE TYPU MAYO-<br>HEGAR, BEZ ŻŁOBNIENIA, SZER. W CZĘŚCI<br>DYSTALNEJ: 4 MM, DŁ. 190 MM  | typu numer katalogowy<br>BM242R  | szt. | 10    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-420 Wrocław ul. Traugutta 116  
tel 343-76-01 fax 071/343-67-47

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

AK MS

## FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Opis wyrobu   | nazwa handlowa,<br>nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena j.<br>netto | VAT % | Kwota j.<br>VAT | Cena j.<br>brutto | wartość<br>netto | kwota<br>VAT | wartość<br>brutto | Producent/<br>uwagi | strony oferty z<br>opisem<br>katalogowym |   |
|------|---|----------------------------------|------|-------|------------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------|--|---|
|      |   |                                  |      |       |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     | 3  | 4 |
| 1    | 2   | 3                                | 4    | 5     | 6                | 7     | 8               | 9                 | 10               | 11           | 12                | 13                  | 14                                       |   |
| -    | -   | -                                | -    | -     | -                | -     | [6x7]           | [6+8]             | [5x6]            | [5x8]        | [5x9]             | -                   | -  | - |
| 26   | IMADŁO CHIRURGICZNE TYPU<br>WANGENSTEEN, DŁ. 275 MM   | typu numer katalogowy<br>BM272R  | szt. | 2     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |   |
| 27   | KUBEK ZE STALI NIERDZEWNEJ, Z<br>UCHWYTEM, POJ. 1 L   | typu numer katalogowy<br>JG518R  | szt. | 6     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |   |
| 28   | KUBEK ZE STALI NIERDZEWNEJ Z<br>UCHWYTEM, POJ. 0,1 L  | typu numer katalogowy<br>JG515R  | szt. | 3     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |   |
| 29   | KUBEK ZE STALI NIERDZEWNEJ Z<br>UCHWYTEM POJ. 0,25 litra  | typu numer katalogowy<br>JG516R  | szt. | 4     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |   |
| 30   | IMADŁO CHIRURGICZNE TYPU ADSON Z<br>OKIENKIEM, DŁ. 180 MM   | typu numer katalogowy<br>BM224R  | szt. | 2     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |   |
| 31   | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYPU<br>METZENBAUM, ZAGIĘTE, DŁ. 200MM                                      | typu numer katalogowy<br>BC607R  | szt. | 4     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |   |
| 32   | WZIERNIK TYPU CUSCO WYMIARY<br>110X37MM   | typu numer katalogowy<br>EL079R  | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |   |
| 33   | NOŻYCZKI DELIKATNE, OSTRE, ZAGIĘTE,<br>DŁ. 115 MM   | typu numer katalogowy<br>BC107R  | szt. | 10    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |   |
| 34   | NOŻYCZKI DO DZIAŁEŁ ZAKRZYWIONE<br>DŁ. 120MM  | typu numer katalogowy<br>DO211R  | szt. | 2     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |   |
| 35   | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYPU<br>METZENBAUM DELIKATNE, WĄSKIE,<br>ODGIĘTE, DŁ. 145 MM                | typu numer katalogowy<br>BC023R  | szt. | 5     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |   |
| 36   | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE STANDARD,<br>PROSTE, TEPE, DŁ. 145 MM                                       | typu numer katalogowy<br>BC314R  | szt. | 10    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |   |
| 37   | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYPU FOMON<br>MOCNO ODGIĘTE DŁ. 115 MM                                      | typu numer katalogowy<br>OK373R  | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |   |
| 38   | IMADŁO CHIRURGICZNE Z TWARDĄ<br>WKŁADKĄ TYPU CONVERSE, NACIĘCIA<br>KRZYWOWE CO 0,2 MM, DŁ. 130 MM | typu numer katalogowy<br>BM011R  | szt. | 10    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |   |
| 39   | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYPU MAYO-<br>HARRINGTON, PROSTE, DŁ. 230 MM                                | typu numer katalogowy<br>BC560R  | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |   |
| 40   | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYPU MAYO,<br>ZAGIĘTE, SZEROKI MODEL, DŁ. 170 MM                            | typu numer katalogowy<br>BC569R  | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |   |

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-420 Wrocław, ul. Traugutta, 116  
tel. 343-76-01 fax 071/343-67-47

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Opis wyrobu  | nazwa handlowa,<br>nr katalogowy | j.m. | ilość | Cena j.<br>netto | VAT % | Kwota j.<br>VAT | Cena j.<br>brutto | wartość<br>netto | kwota<br>VAT | wartość<br>brutto | Producent/<br>uwagi | strony oferty z<br>opisem<br>katalogowym |
|-----|--|----------------------------------|------|-------|------------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------|--|
| 1   | 2  | 3                                | 4    | 5     | 6                | 7     | 8               | 9                 | 10               | 11           | 12                | 13                  | 14                                       |
| -   | -  | -                                | -    | -     | -                | -     | [6x7]           | [6+8]             | [5x6]            | [5x8]        | [5x9]             | -                   | -  |
| 41  | PESETA NOSOWA, BAGNETOWA<br>ANATOMICZNA TYPU JANSEN , DŁ. 160MM                                  | typu numer katalogowy<br>BD880R  | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 42  | PESETA ANATOMICZNA, BAGNETOWA<br>TYPU ADSON, SZER. DYSTALNA: 2,5 MM,<br>DŁ. 175 MM               | typu numer katalogowy<br>BD870R  | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 43  | MŁOTEK TYPU HEATH Z GŁOWICĄ<br>WYPELNIĄ MIEDZIĄ, waga 725 G, SR. 45<br>MM, DŁ. 200 MM            | typu numer katalogowy<br>FL069R  | szt. | 2     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 44  | MŁOTEK 200 G Z WYMIENNYMI DYSKAMI Z<br>TWORZYWA, SR. DYSKÓW: 30 MM, DŁ.<br>245 MM                | typu numer katalogowy<br>FL045R  | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 45  | KLESZCZE DO TRZYMANIA DRUTU TYPU<br>MARBURG, SZCZĘKI OBUSTRONNIE<br>ZĄBKOWANE W KARO, DŁ. 140 MM | typu numer katalogowy<br>DP031R  | szt. | 2     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 46  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU<br>KOCHER, PROSTE 1X2 ZABKI, DŁ. 150 MM                               | typu numer katalogowy<br>BH630R  | szt. | 20    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 47  | IMADŁO CHIRURGICZNE Z PYSZCZKIEM<br>TYPU LAWRENCE , DŁ. 150mm                                    | typu numer katalogowy<br>BM221R  | szt. | 20    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 48  | NOŻYCKI CHIRURGICZNE TYPU DEAYER,<br>PROSTE, JEDNO OSTRZE TĘPE, DRUGIE<br>OSTRE, DŁ. 145 MM      | typu numer katalogowy<br>BC374R  | szt. | 20    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 49  | NOŻYCE DO GIPSU TYPU BERGMANN<br>230MM   | typu numer katalogowy<br>LX553R  | szt. | 3     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 50  | NOŻYCKI DELIKATNE, PROSTE dł.120MM<br>OSTRZE OSTRO OSTRE   | typu numer katalogowy<br>BC064R  | szt. | 2     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 51  | NOŻYCKI PREPARACYJNE TYPU<br>METZENBAUM PROSTE dł.145MM  | typu numer katalogowy<br>BC022R  | szt. | 3     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 53  | KLESZCZE TYPU PEAN COLLER PROSTE,<br>dł. 185 mm  | typu numer katalogowy<br>MD468   | szt. | 10    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| x   | x  | x                                | x    | x     | x                | x     | x               | razem             |                  |              |                   | x                   | x  |

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-420 Wrocław ul. Traugutta 116  
tel. 343-76-01 fax 071/343-67-47



## FORMULARZ CENOWY

| Lp.                 | Opis wyrobu  | nazwa handlowa,<br>nr katalogowy   | j.m. | ilość | Cena j.<br>netto | VAT % | Kwota j.<br>VAT | Cena j.<br>brutto | wartość<br>netto | kwota<br>VAT | wartość<br>brutto | Producent/<br>uwagi | strony oferty z<br>opisem<br>katalogowym |
|---------------------|--|------------------------------------|------|-------|------------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------|--|
| 1                   | 2  | 3                                  | 4    | 5     | 6                | 7     | 8               | 9                 | 10               | 11           | 12                | 13                  | 14                                       |
| -                   | -  | -                                  | -    | -     | -                | -     | [6x7]           | [6+8]             | [5x6]            | [5x8]        | [5x9]             | -                   | -  |
| <b>ZADANIE 577*</b> |  |                                    |      |       |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 1                   | Haczyk do artroskopii śr.3mm,<br>nierozbieralny,laserowo wygrawerowana<br>podziałka w cm na trzonie, rączka płaska z<br>wyźbieniem po obu stronach na palce  | typu numer katalogowy<br>AT304-027 | szt. | 2     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 2                   | Punch artroskopowy, część robocza<br>prostokątna. Wysokość dolnej szczęki 1,5mm,<br>wysokość całkowita szczęki 2,0mm, dł.robocza<br>trzonu 12 cm, część robocza zakrzywiona do<br>góry i w lewo, nierozbieralny  | typu numer katalogowy<br>AT301-004 | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 3                   | Punch artroskopowy , część robocza<br>prostokątna. Wysokość dolnej szczęki 1,5mm,<br>wysokość całkowita szczęki 2,0mm, dł.robocza<br>trzonu 12 cm, część robocza zakrzywiona do<br>góry i w prawo, nierozbieralny  | typu numer katalogowy<br>AT301-005 | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 4                   | Punch artroskopowy , część robocza<br>prostokątna. Wysokość dolnej szczęki 1,5mm,<br>wysokość całkowita szczęki 2,0mm, dł.robocza<br>trzonu 12 cm, część robocza zakrzywiona w<br>lewo, nierozbieralny   | typu numer katalogowy<br>AT301-006 | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 5                   | Kleszce artroskopowe dedykowane przez<br>Producenta do łętki, dł.części roboczej<br>trzonu 17 cm, proste, bransze wewnątrz z<br>mikrozabkami zakończonymi zębami chwytowymi<br>1x2, górną bransz aktywna. Kleszcze<br>wyposażone w śrubę blokującą zamknięcie<br>poprzez dokręcenie. Rekojęść sprzężynowa<br>wyposażona w duży otwór na palec oraz<br>fakturowanie antypoślizgowe. | typu numer katalogowy<br>AT303-020 | szt. | 2     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-220 Wrocław ul. Traugutta 116  
tel. 343-76-01, fax 071/343-67-47

## FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Opis wyrobu  | nazwa handlowa,<br>nr katalogowy | j.m. | ilość | Cena j.<br>netto | VAT % | Kwota j.<br>VAT | Cena j.<br>brutto | wartość<br>netto | kwota<br>VAT | wartość<br>brutto | Producent/<br>uwagi | strony oferty z<br>opisem<br>katalogowym |
|-----|--|----------------------------------|------|-------|------------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------|--|
| 1   | 2  | 3                                | 4    | 5     | 6                | 7     | 8               | 9                 | 10               | 11           | 12                | 13                  | 14                                       |
| -   | -  | -                                | -    | -     | -                | -     | [6x7]           | [6+8]             | [5x6]            | [5x8]        | [5x9]             | -                   | -  |
| 6   | Kleszcze artroskopowe, chwytne, śr.3,5mm, dł.robocza trzonu 13 cm, góna bransza aktywna. Bransze wyposażone w zęby wsteczne. Kleszcze proste z blokadą na palec wskazujący, nierozbieralne.        | typu numer katalogowy AT302-001  | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 7   | Kleszcze artroskopowe, chwytno-biopsyjne, śr.3,5mm, dł.robocza trzonu 13 cm, góna bransza aktywna. Bransze wyposażone w zęby oraz zębienia biopsyjne. Kleszcze proste bez blokady, nierozbieralne. | typu numer katalogowy AT 302-014 | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 8   | Kleszcze artroskopowe, chwytne, śr.2,7mm, dł.robocza trzonu 13 cm, góna bransza aktywna. Bransze wyposażone w zęby wsteczne. Kleszcze proste bez blokady, nierozbieralne.                          | typu numer katalogowy AT302-012  | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 9   | Punch artroskopowy, owalny, część robocza owalna. Wysokość dolnej szczęki 1,5mm, wysokość całkowita szczęki 2,0mm, dł.robocza trzonu 12 cm, prosty, nierozbieralny                                 | typu numer katalogowy AT300-030  | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 10  | Punch artroskopowy część robocza prostokątna. Wysokość dolnej szczęki 1,5mm, wysokość całkowita szczęki 2,0mm, dł.robocza trzonu 12 cm, prosty, nierozbieralny                                     | typu numer katalogowy AT300-001  | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 11  | Kleszcze artroskopowe, chwytne, bransze lekko zębione i fakturwane. Góna bransza aktywna. Wysokość całkowita szczęki 4,5mm, dł.robocza trzonu 12 cm, proste, nierozbieralne                        | typu numer katalogowy AT301-072  | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 12  | Nożyczki artroskopowe typu Punch, góna bransza aktywna. Wysokość dolnej szczęki 1,5mm, wysokość całkowita szczęki 2,0mm, dł.robocza trzonu 12 cm, proste, nierozbieralne                           | typu numer katalogowy AT301-060  | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| X   | X  | X                                | X    | X     | X                | X     | X               | razem             |                  |              |                   | X                   | X  |

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-420 Wrocław ul. Traugutta 116

SKK  
MS

## FORMULARZ CENOWY

| Lp.                 | Opis wyrobu  | nazwa handlowa,<br>nr katalogowy        | J.m. | ilość | Cena j.<br>netto | VAT % | Kwota j.<br>VAT | Cena j.<br>brutto | wartość<br>netto | kwota<br>VAT | wartość<br>brutto | Producent/<br>uwagi | strony oferty z<br>opisem<br>katalogowym |
|---------------------|--|---|------|-------|------------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------|--|
| 1                   | 2  | 3                                       | 4    | 5     | 6                | 7     | 8               | 9                 | 10               | 11           | 12                | 13                  | 14                                       |
| -                   | -  | -                                       | -    | -     | -                | -     | [6x7]           | [6+8]             | [5x6]            | [5x8]        | [5x9]             | -                   | -  |
| <b>ZADANIE 67**</b> |  |   |      |       |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 1                   | KLESZCZE DO DRUTU UTWARDZANE<br>PLASKIE NOSKI DL. 18CM   | typu numer katalogowy<br>22-511-02      | szt. | 2     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 2                   | SRUBOKRĘT FI 6MM ZE SZTUCZNA<br>REKOJEŚCIĄ 25CM  | typu numer katalogowy<br>22-380-25      | szt. | 2     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| x                   | x  | x                                       | x    | x     | x                | x     | x               | razem             |                  |              |                   | x                   | x  |
| <b>ZADANIE 77**</b> |  |   |      |       |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 1                   | GRASPER kompatybilny do RĄCZKI BERYLA<br>TYPU BIRKETT, DL. ROBOCZA 21MM,<br>SZCZĘKI WYDŁUŻONE, POPRZECZNIKIE<br>ROWKOWANE, W CZĘŚCI DYSTALNEJ  | typu numer katalogowy<br>3281           | szt. | 2     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 2                   | NOŻYCZKI kompatybilne DO RĄCZKI<br>BERYLA DO LAPAROSKOPII O DŁUGOŚCI<br>ROBOCZEJ OSTRZA 13,46MM  | typu numer katalogowy<br>3111           | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| x                   | x  | x                                       | x    | x     | x                | x     | x               | razem             |                  |              |                   | x                   | x  |
| <b>ZADANIE 87**</b> |  |   |      |       |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 1                   | LITOTRYPTOR rozkładalny na 3 części,<br>rączka pistoletowa ze spoczynkiem na palec,<br>szaft zewnętrzny z branszą górną, szaft<br>wewnętrzny z branszą dolną, system łączenia<br>z cystoskopem na „click”, 2 zawory<br>przepływowe, kompatybilny z cystoskopem | typu numer katalogowy<br>253-755-500 RZ | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 2                   | ELEMENT PRACUJĄCY DO NACIĘCIA<br>CEWKI Monopolarny element pracujący do<br>nacięcia cewki, aktywny z rączką tytanową, ze<br>spoczynkiem na palec, oczko na kciuk-<br>obrotowe, kompatybilny z płaszczem i<br>elektrodami                                       | typu numer katalogowy<br>253-000-201RZ  | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 3                   | KLESZCZE DO BIOPSJI 7 Char., dł. 40cm,<br>śr. 2,3mm; bransze owalne z ostrymi zębami,<br>obie aktywne; szaft giętki, obrotowy, narzędzie<br>rozkładalne  | typu numer katalogowy<br>351-124-107RZ  | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 4                   | KLESZCZYKI DO LITOTRYPTYKI, do małych<br>kamieni, jedna bransza aktywna, kompatybilne<br>z płaszczem cystoskopowym 25 Char. i<br>płaszczem resektoskopowym 26/28 Char.   | typu numer katalogowy<br>253-760-000RZ  | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 5                   | NÓZ DO CIĘCIA CEWKI Nóż do cięcia cewki<br>typu „WaveCut”, 24 Char., prosty,<br>kompatybilny z monopolarnym elementem<br>pracującym  | typu numer katalogowy<br>353-500-564RZ  | szt. | 3     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| x                   | x  | x                                       | x    | x     | x                | x     | x               | razem             |                  |              |                   | x                   | x  |

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## FORMULARZ CENOWY

| Lp.                 | Opis wyrobu   | nazwa handlowa,<br>nr katalogowy | J.m. | ilość | Cena j.<br>netto | VAT % | Kwota j.<br>VAT | Cena j.<br>brutto | wartość<br>netto | kwota<br>VAT | wartość<br>brutto | Producent/<br>uwagi | strony oferty z<br>opisem<br>katalogowym |
|---------------------|---|----------------------------------|------|-------|------------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------|--|
| 1                   | 2   | 3                                | 4    | 5     | 6                | 7     | 8               | 9                 | 10               | 11           | 12                | 13                  | 14                                       |
| -                   | -   | -                                | -    | -     | -                | -     | [6x7]           | [6+8]             | [5x6]            | [5x8]        | [5x9]             | -                   | -  |
| <b>ZADANIE 97**</b> |   |                                  |      |       |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 1                   | Nożyczki naczyniowe, proste, jedna bransza ostra, druga zakończona kulką, dł. 11,5 cm         | typu numer katalogowy RU 1705-11 | szt. | 2     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 2                   | Nożyczki typu Mayo-Stille, proste, tępo-tępe, dł. 14,5 cm                                     | typu numer katalogowy RU 1260-15 | szt. | 25    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 3                   | Pęseta typu Brophy, anatomiczna, prosta, z bolcem naprowadzającym, dł. 20 cm                  | typu numer katalogowy 020-094-20 | szt. | 15    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 4                   | Pęseta typu Waugh, anatomiczna, prosta, z bolcem naprowadzającym, dł. 20 cm                   | typu numer katalogowy 020-130-20 | szt. | 15    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 5                   | Kleszcze typu Kocher Ochsner, 1x2 zęby, proste, dł. 18cm                                      | typu numer katalogowy 040-350-18 | szt. | 20    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 6                   | Kleszcze typu Kocher Ochsner, 1x2 zęby, zakrzywione, dł. 18cm                                 | typu numer katalogowy 040-351-18 | szt. | 10    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 7                   | Kleszcze typu Kocher Ochsner, 1x2 zęby, proste, dł. 16cm                                      | typu numer katalogowy 040-350-16 | szt. | 10    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 8                   | Kleszcze typu Kocher Ochsner, 1x2 zęby, zakrzywione, dł. 16cm                                 | typu numer katalogowy 040-351-16 | szt. | 10    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 9                   | Retraktor do ran typu Langenbeck, rączka azurowa, wym. 25x6mm, dł. 21,5 cm                    | typu numer katalogowy RU 4538-11 | szt. | 1     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 10                  | Kleszcze typu Rochester Pean, proste, dł. 24 cm   | typu numer katalogowy 040-260-24 | szt. | 5     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 11                  | Kleszcze typu Pean Delicate, proste, dł. 14 cm  | typu numer katalogowy 040-262-14 | szt. | 10    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 12                  | Imadło do szycia typu Mayo Hegar, proste, bransza żłobiona, fakturowana krzyżowo, dł. 16 cm   | typu numer katalogowy RU6000-16  | szt. | 10    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 13                  | Imadło typu Hegar, proste, masywny kształt, bransza żłobiona i fakturowana krzyżowo, dł. 16cm | typu numer katalogowy RU 6004-16 | szt. | 10    |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 15                  | Hak skórný typu Gillies, duży, fig.2, dł. 18 cm   | typu numer katalogowy RU 6296-01 | szt. | 2     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 16                  | Hak do ran, 3 zębny, ostry, dł. 16 cm   | typu numer katalogowy RU 4462-03 | szt. | 2     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |
| 17                  | Igła z kulka, giętka, podłączenie luer-lock, śr. 4mm, dł. 15 cm                               | typu numer katalogowy 086-140-04 | szt. | 2     |                  |       |                 |                   |                  |              |                   |                     |  |

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Polnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. P. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-120 Wrocław, ul. Traugutta 116  
tel. 343-76-01 fax 071/343-67-47

Handwritten initials and a number '2' in the top right corner.

## FORMULARZ CENOWY

| L.p.                | Opis wyrobu   | nazwa handlowa, nr katalogowy    | j.m. | Ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent/ uwagi | strony oferty z opisem katalogowym |
|---------------------|---|----------------------------------|------|-------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 1                   | 2   | 3                                | 4    | 5     | 6             | 7     | 8            | 9              | 10            | 11        | 12             | 13               | 14                                 |
| -                   | -   | -                                | -    | -     | -             | -     | [6x7]        | [6+8]          | [5x6]         | [5x8]     | [5x9]          | -                | -                                  |
| 18                  | Trzonek do skalpela nr.3, dł. 12,5 cm   | typu numer katalogowy RU 4850-03 | szt. | 2     |               |       |              |                |               |           |                |                  |                                    |
| 19                  | Trzonek do skalpela nr.4, dł. 13,5cm  | typu numer katalogowy RU 4850-04 | szt. | 2     |               |       |              |                |               |           |                |                  |                                    |
| 20                  | Rozwierak automatyczny typu Weillaner, tępy, 3x4 zęby, dł. 13 cm  | typu numer katalogowy RU 4701-13 | szt. | 1     |               |       |              |                |               |           |                |                  |                                    |
| 21                  | Kubek z uchwytem, kształt stożkowy, pojemność 250ml   | typu numer katalogowy RU 8975-25 | szt. | 2     |               |       |              |                |               |           |                |                  |                                    |
| 22                  | Nożyczki preparacyjne typu Metzbaum, tępe, zakrzywione, bransza ząbkowana typu Super Cut, ucha i rękojeści czemione, dł. 18cm.        | typu numer katalogowy RU1331-18  | szt. | 8     |               |       |              |                |               |           |                |                  |                                    |
| 23                  | Nożyczki preparacyjne typu Toennis Adson, tępe, zakrzywione, bransza ząbkowana typu Super Cut, ucha i rękojeści czemione, dł. 17,5cm. |                                  | szt. | 5     |               |       |              |                |               |           |                |                  |                                    |
| x                   |   |                                  | x    | x     | x             | x     | x            | razem          |               |           |                | x                | x                                  |
| <b>ZADANIE 10**</b> |   |                                  |      |       |               |       |              |                |               |           |                |                  |                                    |
| 23                  | LYZKI BOCZNE DO ROZWIERACZA TYPU MILLIN O WYM. 82X25 MM   | typu numer katalogowy BV577R     | szt. | 1     |               |       |              |                |               |           |                |                  |                                    |
| <b>ZADANIE 11**</b> |   |                                  |      |       |               |       |              |                |               |           |                |                  |                                    |
| 14                  | Młotek neurologiczny typu Babinsky z igłą, długość 24 cm.   | typu numer katalogowy RU 5005-24 | szt. | 1     |               |       |              |                |               |           |                |                  |                                    |

# Parametry techniczne wymagane dla Zadania 1 pozycji 1 i Zadania 2 pozycji 1 zostały wykazane w "Kartach parametrów", stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

\* Zamawiający wymaga, aby w cenę przedmiotu zamówienia zostało wliczone wykonanie przez Wykonawcę na każdej sztuce narzędzi znakowania laserowego, zgodnie z wzorami przedłożonymi przez Zamawiającego (ww. wzory będą zawierały max. 10 znaków i zostaną przekazane Wykonawcy wraz z zamówieniem).

\*\* Wymagana identyfikacja systemem Data Matrix. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenia.

**Uwaga:**

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego wypełnienia kolumn w wyznaczonym zakresie, ponieważ w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, powyższy "Formularz cenowy" będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-120 Wrocław, ul. Trajgultka 116  
tel. 343-76-01, fax 071/343-67-47

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## KARTA PARAMETRÓW - Zadanie 1

| l.p.  | parametry techniczne   | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe |
|---|--|--|-------------------------------|
| <b>Parametry techniczne napędu akumulatorowego do nasadek wiertarskich i frezerskich oraz piły oscylacyjnej</b> |  |  |                               |
| <b>WYMAGANE</b>   |  |  |                               |
| 1   | Pistoletowa rękojeść wiertarska nie wymagająca smarowania w pełni autoklawowalna   |  | -                             |
| 2   | Silnik o mocy $\geq 250W$ sterowany elektronicznie   |  | -                             |
| A   | Regulacja obrotów w zakresie minimum:  |  | -                             |
|   | • 0-1000 obr/min dla nasadek wiertarskich  |  | -                             |
|   | • 0-250 obr/min dla nasadek frezerskich  |  | -                             |
| B   | Zmiana kierunku obrotów lewo, prawo  |  | -                             |
| C   | Rękojeść wyposażona w sprzęgło przeciążeniowe  |  | -                             |
| 3   | Możliwość zatraskowego montażu końcówek roboczych o przełożeniach 1:1; 3:1; 5:1  |  | -                             |
| 4   | Piła oscylacyjna o obrotowej głowicy i oscylacji max 11000cpm (cykli na minutę)  |  | -                             |
| A   | Ostrza jednorazowe montowane zatraskowo w ilość 10 szt. do wyboru z katalogu   |  | -                             |
| 5   | Niesterylizowalne baterie 2szt. wraz z pojemnikami i osłonami do sterylnego podawania 2 komplety   |  | -                             |
| A   | adapter do ładowarki umożliwiający równoczesne ładowanie min 2 baterii niesterylizowalnych lub ładowarka   |  | -                             |
| 6   | Blokada przed przypadkowym niezamierzonym uruchomieniem  |  | -                             |
| 7   | Wyposażenie:   |  | -                             |
| A   | Rozwiertak do frezowania panewek do endoprotez typu Aeskulap o przełożeniu 3:1   |  | -                             |
| B   | Wiertarka z uchwytem typu Jacobs wraz z kluczykiem z możliwością mocowania wiertel o średnicy min. 0,6- 6 mm z przełożeniem 1:1 i kaniulacją 6,4mm |  | -                             |
| <b>DODATKOWE</b>  |  |  |                               |
| 1   | Dwie odrębne pistoletowe rękojeści   |  | 0/5                           |
| 2   | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem typu PRO 6200M  |  | 0/5                           |
| <b>RAZEM:</b>   |  |  | <b>0-10</b>                   |

**Uwaga:**  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych w „Karcie parametrów” parametrów technicznych, w przypadku braku potwierdzenia ich w materiałach w języku polskim z danymi technicznymi producenta wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”

| <b>KARTA PARAMETRÓW - Zadanie 2</b>                      |   |   |                                      |
|--|---|---|--------------------------------------|
| <b>I.p.</b>  | <b>parametry techniczne</b>   | <b>strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru</b> | <b>punkty za parametry dodatkowe</b> |
| <b>Parametry techniczne wstrzykiwacza automatycznego</b> |   |   |                                      |
| <b>WYMAGANE</b>  |   |   |                                      |
| 1  | Wstrzykiwacz do wewnątrznaczyniowego podawania ogrzanych kontrastów i zwykłych środków do przepłukiwania w angiografii  |   | -                                    |
| 2  | Zintegrowany cokół - Iniektor wraz z panelem sterowania zainstalowany na podstawie jezdnej z możliwością blokowania kół |   | -                                    |
| 3  | Intuicyjny interfejs  |   | -                                    |
| 4  | Strzykawka ładowana od przodu   |   | -                                    |
| 5  | Objętość min. od 1-150ml z regulacją  |   | -                                    |
| 6  | Limit ciśnienia min. od 100psi do 8000kPa z regulacją   |   | -                                    |
| 7  | Natężenie przepływu min. od 0,1-50 ml z regulacją   |   | -                                    |
| 8  | czas narastania min. od 1- 9s z regulacją   |   | -                                    |
| 9  | opóźnienie min. od 1- 90s z regulacją   |   | -                                    |
| 10   | szybkość napełniania min. 1-20ml/s  |   | -                                    |
| 11   | pamięć protokółów min.30  |   | -                                    |
| 12   | możliwość zapisania iniekcji w pamięci min.30   |   | -                                    |
| 13   | podgrzewacz kontrastu   |   | -                                    |
| 14   | kabel interfejsu do podłączenia do angiografu   |   | -                                    |
| 15   | kabel do ręcznego wyzwiania iniekcji dł.min. 150cm  |   | -                                    |
| 16   | pakiet startowy jednorazowych wkładów oraz niezbędnego asortymentu do natychmiastowego użytkowania po zainstalowaniu    |   | -                                    |
| <b>DODATKOWE</b>   |   |   |                                      |
| 1  | Wsztrzykiwacz automatyczny kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem Mark 7 firmy MEDRAD                   |   | 0/10                                 |
| <b>RAZEM:</b>  |   |   | <b>0-10</b>                          |

**Uwaga:**

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia przez zaoficerowany asortyment wyspecyfikowanych w „Karcie parametrów” parametrów technicznych, w przypadku braku potwierdzenia ich w materiałach w języku polskim z danymi technicznymi producenta wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”

Dotyczy Zadania 3-11

Po procedurze przeprowadzonej zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, według sygnatury sprawy EZ/345/109/15 zostaje zawarta niniejsza umowa

**UMOWA DOSTAWY Nr .... / 109 / 15 – wzór II**

zawarta w dniu ..... we Wrocławiu pomiędzy:

**Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. R. Traugutta 116, 50-420 Wrocław**

**zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,  
reprezentowanym przez Marka Nikla – Dyrektora, którego zastępuje:**

- 1) Katarzyna Kapuścińska – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
  - 2) Marian Wolski - Główny Księgowy
- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....  
z/s .....

- zwanym dalej „Wykonawcą”,

który reprezentuje:

- 1) .....
- 2) .....

- zwanym dalej „Wykonawcą”

**§ 1**

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawy narzędzi wg Zadania ... dla szpitala w lokalizacjach: ul. Traugutta 116 we Wrocławiu, al. Wiśniowa 36 we Wrocławiu, lub lokalizacja Zamawiającego przy ul. gen. A.E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – zwane dalej „przedmiotem umowy”.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu dostawy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie .... dni (*dla Zadania 3 – 7 dni – 20,00 pkt/ 14 dni – 0,00 pkt dla Zadań 4-11: 14 dni – 20,00 pkt/ 28 dni – 0,00 pkt*) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia.
4. Strony uznają faks za obowiązujący dokument zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości oraz cykliczności dostaw.
6. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.
7. Na 3 dni przed dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy
8. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnego zakresu zamówienia objętego przedmiotem umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 5 % wartości umowy brutto.
9. Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości towaru.
10. Dostawa towaru bez potwierdzenia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty.
11. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, dokumenty dopuszczające w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych do obrotu i stosowania na terenie RP wyroby medyczne wykazane w Załączniku nr 1.
12. Wykonawca zobowiązuje się w cenie przedmiotu zamówienia wykonać znakowanie laserowe na każdej sztuce narzędzi, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, zgodnie ze wzorem Zamawiającego, przekazany wraz zamówieniem. Wykonawca zobowiązuje dostarczać oznakowane narzędzia w terminie wskazanym w § 1 ust. 3 niniejszej umowy (*dotyczy Zadań 4-9*).

**§ 2**

Ogólna wartość brutto przedmiotu umowy wynosi ..... zł (słownie: .....), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.



Dotyczy Zadania 3-11

§ 3

1. Z chwilą przekazania – odbioru towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego – na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty i zniszczenia towaru.
2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu jak i za właściwe opakowanie towaru.
3. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy ..... (*własnymi siłami / z udziałem podwykonawców*). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony i odebrany towar wynagrodzenie obliczone zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający płaci Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu wystawionej faktury w wersji papierowej, przelewem na konto bankowe Wykonawcy .....
3. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres obowiązywania umowy.
4. Stałość cen, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny wyrobów wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie, w całym okresie obowiązywania umowy.
5. W przypadku zmian stawek podatku VAT, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.
6. Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 8 ust. 4 umowy.
7. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikającą ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.
2. Gwarancję ustala się na okres ..... (*12 miesięcy dla Zadania 3 / 24 miesiące dla Zadań 4-11*) od dnia dokonania odbioru.
3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia.
4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ..... do .....
2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca:
  - 1) nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy,
  - 2) wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi,
  - 3) nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,
  - 4) dostarcza Zamawiającemu towar, którego parametry techniczne nie odpowiadają zapisom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu wydane zostanie w formie pisemnej.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.
3. Jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie – zapłaci wówczas Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy

### Dotyczy Zadania 3-11

- określonej w § 2 niniejszej umowy.
4. Zamawiający może uznać za przerwanie wykonywania przez Wykonawcę umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zamówienia dłużej niż 6 dni od terminu określonego w §1 ust. 3 niniejszej umowy.
  5. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
    - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
    - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.
  7. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także o zwrot utraconego zysku.
  8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
  9. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

### § 8

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 2 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także o zwrot utraconego zysku. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Oprócz wypadków wskazanych w § 4 Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
  - 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.),
  - 2) zmiany miejsca realizacji umowy,
  - 3) zmiany asortymentu (wycofanie starego i wprowadzenie nowego wyrobu w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach w cenie nie wyższej niż przetargowa),
  - 4) w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w załączniku nr 1, Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 nie więcej niż o 6 miesięcy,
  - 5) zmiany konta bankowego.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
8. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

Dołnośląski Szpital Specjalistyczny  
Im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
60-420 Wrocław ul. Traugutta 116  
tel. 343-76-01 fax 071/343-67-47

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 112723-2015 z dnia 2015-07-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław

1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy narzędzi i aparatury medycznej wg niżej wymienionych części: Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5, Zadanie 6, Zadanie 7, Zadanie 8, Zadanie 9. Powyższe części...  
Termin składania ofert: 2015-08-05

**Numer ogłoszenia: 120495 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 112723 - 2015 data 28.07.2015 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Traugutta 116,  
50-420 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3414333, fax. 071 3436747.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy narzędzi i aparatury medycznej wg niżej wymienionych części: Zadanie 1,

Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5, Zadanie 6, Zadanie 7, Zadanie 8, Zadanie 9. Powyższe

części przedmiotu zamówienia wykazane zostały i opisane w Formularzu cenowym oraz Kartach

parametrów, stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.2. Miejsce

wykonywania ww. dostaw: lokalizacje ul. Traugutta 116 we Wrocławiu, al. Wiśniowa 36 we Wrocławiu,

lub lokalizacja Zamawiającego przy ul. gen. A.E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 1.3. Warunki umowne

realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące integralną część

SIWZ. Szacunkowa wartość zamówienia: 289 608,11 złotych netto.

W ogłoszeniu, powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1.

Przedmiotem zamówienia są dostawy narzędzi i aparatury medycznej wg niżej wymienionych części:

Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5, Zadanie 6, Zadanie 7, Zadanie 8, Zadanie 9,

Zadanie 10, Zadanie 11. Powyższe części przedmiotu zamówienia wykazane zostały i opisane w

Formularzu cenowym oraz Kartach parametrów, stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia. 1.2. Miejsce wykonywania ww. dostaw: lokalizacje ul. Traugutta 116 we

Wrocławiu, al. Wiśniowa 36 we Wrocławiu, lub lokalizacja Zamawiającego przy ul. gen. A.E. Fieldorfa 2

we Wrocławiu. 1.3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają

wzory umów, stanowiące integralną część SIWZ. Szacunkowa wartość zamówienia: 289 608,11 złotych netto.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5.

W ogłoszeniu jest: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIEDAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym

wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone,

kórych autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; inne

dokumenty a) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone w

rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych do obrotu i stosowania terenie RP (dotyczy wszystkich

wyspecyfikowanych w Formularzu cenowym pozycji przedmiotu zamówienia), b) materiały w języku

polskim z danymi technicznymi producenta wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (np.

instrukcje użytkownika, strony katalogów itp.) potwierdzające wyspecyfikowane parametry oraz nazwę

producenta zaofertowanego asortymentu (są to wymagania minimalne - dopuszcza się wszystkie cechy

dotatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu), dopuszcza się własne tłumaczenie (może być

wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełnienia

wyspecyfikowanych parametrów); w kolumnie strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający

spełnienie parametru Karty Parametrów oraz kolumnie strony oferty z opisem katalogowym Formularza

cenowego Wykonawca wpisuje numer strony oferty, na której umieszczona jest informacja

potwierdzająca spełnienie określonych przez Zamawiającego parametrów (dopuszcza się wpisanie

ręczne), brak potwierdzenia parametrów wymaganych uznany zostanie za niespełnienie przez

oferowany asortyment tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzić będą

przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a w przypadku parametrów dodatkowych (dotyczy

Zadania 1 i Zadania 2)- brak potwierdzenia skutkować będzie nieprzyznaniem określonej ilości punktów.

Materiały składane w formie kopii winne być poświadczone za zgodność z oryginałem oraz podpisane

przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. UWAGA! - W przypadku braku w ww.

materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie

oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą

producenta wskazaną w Formularzu cenowym, - W Zadaniu 1 i Zadaniu 2 Zamawiający dopuszcza

możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia przez zaofertowany

asortyment wyspecyfikowanych Kartach parametrów parametrów, w przypadku braku potwierdzenia ich

w ww. materiałach w języku polskim z danymi technicznymi producenta wraz z wyspecyfikowanymi

numerami katalogowymi, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać

nazwę potwierdzonego parametru, zgodnie z zapisami Kart parametrów, c) oświadczenie,

potwierdzające że oferowany asortyment jest identyfikowany za pomocą systemu Data Matrix (dotyczy

Zadań 4-9).

W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; inne dokumenty a) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych do obrotu i stosowania terenie RP (dotyczy wszystkich wyspecyfikowanych w Formularzu cenowym pozycji przedmiotu zamówienia), b) materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (np. instrukcje użytkowania, strony katalogów itp.) potwierdzająca wyspecyfikowane parametry oraz nazwę producenta zaofertowanego asortymentu (są to wymagania minimalne - dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu), dopuszcza się własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełnienia wyspecyfikowanych parametrów); w kolumnie strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnienie parametru Karty Parametrów oraz kolumnie strony oferty z opisem katalogowym Formularza cenowego Wykonawca wpisuje numer strony oferty, na której umieszczona jest informacja potwierdzająca spełnienie określonych przez Zamawiającego parametrów (dopuszcza się wpisanie ręczne), brak potwierdzenia parametrów wymaganych uznany zostanie za niespełnienie przez oferowany asortyment tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. a w przypadku parametrów dodatkowych (dotyczy Zadania 1 i Zadania 2)- brak potwierdzenia skutkować będzie nieprzyznaniem określonej ilości punktów. Materiały składane w formie kopii winne być poświadczane za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. UWAGA! - W przypadku braku w ww. materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być bszsma z nazwą producenta wskazaną w Formularzu cenowym. - W Zadaniu 1 i Zadaniu 2 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia przez zaofertowany asortyment wyspecyfikowanych Kartach parametrów parametrów, w przypadku braku potwierdzenia ich w ww. materiałach w języku polskim z danymi technicznymi producenta wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzonego parametru, zgodnie z zapisami Kart parametrów, c) oświadczenie, potwierdzające że oferowany asortyment jest identyfikowany za pomocą systemu Data Matrix (dotyczy Zadań 4-11).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.

W ogłoszeniu jest: WADIUM Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie 1 - 700,00 złotych, Zadanie 2 - 1 900,00

złotych, Zadanie 3 - 288,00 złotych, Zadanie 4 - 1 396,00 złotych, Zadanie 5 - 663,00 złotych, Zadanie 6 - 69,00 złotych, Zadanie 7 - 51,00 złotych, Zadanie 8 - 340,00 złotych, Zadanie 9 - 385,00 złotych. Łączna wysokość wadium: 5 792,00 złote. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W ogłoszeniu powinno być: WADIUM Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie 1 - 700,00 złotych, Zadanie 2 - 1 900,00 złotych, Zadanie 3 - 288,00 złotych, Zadanie 4 - 1 387,00 złotych, Zadanie 5 - 663,00 złotych, Zadanie 6 - 69,00 złotych, Zadanie 7 - 51,00 złotych, Zadanie 8 - 340,00 złotych, Zadanie 9 - 382,00 złotych, Zadanie 10 - 3,00 złotych, Zadanie 11 - 9,00 złotych. Łączna wysokość wadium: 5 792,00 złote. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2015 godzina 13:00, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Traugutta 116 bud. C. II piętro, pokój 210.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2015 godzina 13:00, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Traugutta 116 bud. C. II piętro, pokój 210.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Cz. 4.

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy narzędzi, wymaganych i opisanych w Formularzu cenowym stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 53 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2. Termin dostawy - 20.

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy narzędzi, wymaganych i opisanych w Formularzu cenowym stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 52 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2. Termin dostawy - 20.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Cz. 9.

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie 9. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy narzędzi, wymaganej i opisanej w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 23 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2. Termin dostawy - 20.

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie 9. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy narzędzi, wymaganej i opisanej w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 22 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2. 3)

Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2. Termin dostawy - 20.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7.

W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Cz. 10.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie 10. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy narzędzi, wymaganych i opisanych w

Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik

Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6. 4)

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2.

Termin dostawy - 20.

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Cz. 11.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zadanie 11. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy narzędzi, wymaganych i opisanych w

Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik

Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6. 4)

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2.

Termin dostawy - 20.